

AL LEGATO

A)

ALLA

DELIBERAZIONE

N.

310

DEL

CCMPCSTC

DA

N.

92

PAGINE

28 GIUGNO 2011

## AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – BIELLA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

### IL COMMISSARIO

**Dr.ssa Carla Peona**

*(nominata con D.G.R. n. 52 -1359 del 29 Dicembre 2010)*

L'anno duemilaundici, il giorno 13 del mese di Aprile in Biella, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

***ha assunto la seguente deliberazione:***

**DELIBERAZIONE n. 182 del 13-04-2011**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLA AA.SS. DELL'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. MAGGIORE DELLA CARITÀ NOVARA). AGGIUDICAZIONE.



# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 1 di 6

Atti n. 487 MR/EM/rcm

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara). Aggiudicazione.

### IL COMMISSARIO

Su proposta n. 5 della Struttura Organizzativa Complessa Approvvigionamento di Beni dalla cui istruttoria si evince che:

- con deliberazione n° 110 del 23.02.2010 è stata indetta Procedura aperta per della fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara (cod. CIG: Lotto 1 0440098C58, Lotto 2 0440100DFE) ed approvati i relativi atti di gara;
- il bando di gara é stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee (04/03/2010) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (05/03/2010); l'avviso per estratto sui quotidiani Italia Oggi (17/03/10), MF/Milano Finanza Quotidiano Nazionale (18/03/10), M/F Milano Finanza ed. Locale (20/03/10) e La Stampa ed. locale (16/03/2010), nonché tutti gli atti di gara sul sito aziendale con scadenza, per la ricezione delle offerte, fissata per le ore 16,00 del giorno 16.04.10 prorogata, in seguito a richiesta di chiarimenti da parte delle ditte interessate, alle ore 16,00 del giorno 26.04.2010;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 280 del 29.04.2010 e successivi provvedimenti n° 461 del 14.07.2010 e 52 del 04.02.2011 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle Ditte partecipanti alla procedura oggetto del presente atto;
- dal verbale, redatto dall'Ufficiale Rogante n° 2150 di Repertorio del 30.04.2010, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 1), relativo all'apertura dei plichi principali e delle buste "Documentazione Amministrativa", contenenti la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, risulta che entro il termine previsto nel bando di gara, successivamente prorogato con nota prot. 11174 del 01.04.2010, per la ricezione delle offerte (ore 16,00 del 26.04.2010) sono pervenuti i plichi inviati dalle Ditte di seguito indicate:
  1. HILL ROM S.p.a. di Rodano (MI);
  2. KCI MEDICAL di Assago (MI);
  3. MEDI FM SERVICE S.r.l. di Volpino (TO);



# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 2 di 6

- dall'apertura dei plichi principali di cui sopra risulta che le ditte HILL ROM, KCI MEDICAL sono state ammesse alle fasi successive della gara per entrambi i lotti 1 e 2 mentre la ditta MEDI FM SERVICE è stata ammessa al prosieguo della gara per il lotto 1 e ammessa con riserva di verificare la possibilità dell'avvalimento per il lotto 2;
- dal verbale redatto dall'Ufficiale Rogante n° 2237 di Repertorio del 28.03.11, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 2), relativo all'apertura delle offerte economiche risulta quanto segue:
  1. la Ditta MEDI FM SERVICE ammessa con riserva nella seduta del 30.04.2010, a seguito della verifica effettuata sulla legittimità dell'avvalimento presentato per il lotto 2, è stata ammessa al prosieguo della gara;
  2. i controlli effettuati ex 48 del D.L.vo n° 163/2006 sulla ditta KCI MEDICAL hanno dato esito positivo;
  3. la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n° 280 del 29.04.2010 e successiva n° 461 del 14.07.2010 si è riunita nelle sedute del 25.08.2010 e del 30.11.2010 redigendo appositi verbali;
  4. a seguito di informativa di ricorso da parte della ditta MEDI FM SERVICE l'Azienda ha provveduto a rinviare la procedura di apertura delle offerte economiche e la Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 13.12.2010, ha riaperto l'esame valutativo sugli aspetti tecnici sollevati dalla ditta MEDI FM;
  5. a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione Giudicatrice con delibera n° 52 del 04.02.2011 del Commissario dell'Azienda, si è proceduto a rinominare la Commissione Giudicatrice, confermando il Presidente e i componenti rimasti dando mandato alla medesima di riesaminare gli atti di gara e l'attività espletata;
  6. la Commissione Giudicatrice che si è riunita nei giorni 07 e 21 marzo 2011 per l'espletamento delle attività di competenza redigendo appositi verbali, allegati al presente atto a parte integrante e sostanziale (All.to 3 e All.to 4), ha assegnato i seguenti punteggi qualità

### LOTTO 1

Ditta HILL - ROM

Punti 48,8 - Normalizzato a punti 50

Ditta KCI MEDICAL

Punti 44,2 - Normalizzato a punti 45,286



# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 3 di 6

### LOTTO 2

Ditta HILL ROM	Punti 33
Ditta KCI MEDICAL	Punti 50
Ditta MEDI FM SERVICE	Punti 27,5

7. la ditta MEDI FM SERVICE viene esclusa dal prosieguo della gara relativamente al Lotto 1 in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto non idoneo il prodotto offerto da questa ditta per il sotto lotto B) (mod. AIR EXPRESS) e secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara che prevede l'aggiudicazione congiunta dei sotto lotti A) e B);
8. a seguito dell'apertura delle offerte economiche, con la Commissione Giudicatrice presente al completo, viene formulata la seguente graduatoria con conseguente individuazione della ditta KCI MEDICAL quale aggiudicataria provvisoria avendo offerto il costo complessivo per tre anni rispettivamente:

LOTTO 1: pari ad € 1.581.000,00 (Iva 20% esclusa);

LOTTO 2: pari ad € 588.000,00 (Iva 20% esclusa);

GRADUATORIA		PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
LOTTO 1				
1°	K.C.I. MEDICAL S.r.l. € 1.581.000,00 Iva esclusa	45,286	50	95,286
2°	HILL ROM S.p.a. € 1.755.000,00 Iva esclusa	50	45,04	95,04



Lp

# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 4 di 6

GRADUATORIA		PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
LOTTO 2				
1°	K.C.I. MEDICAL S.r.l. € 588.000,00 Iva esclusa	50	37,05	87,05
2°	HILL ROM S.p.a. € 435.750,00 Iva esclusa	33	50	83
	MEDI FM SERVICE € 443.625,00 Iva esclusa	27,5	49,11	76,61

l'aggiudicazione in parola comporta per le AA.SS.LL. e A.S.O. dell'Area Sovrazonale "NO", per il periodo della fornitura di 36 mesi, un onere pari ad € 2.602.800,00 Iva 20% inclusa facendo registrare, rispetto di prezzi della precedente aggiudicazione messi a gara, un risparmio come di seguito dettaglio:

- Lotto 1: mediamente del 32% circa;
- Lotto 2: del 39,459%;
- come disposto dal D.Lg.vo n° 163/2006 art. 87, sono state fornite con nota del 29.03.2011 agli atti dalla ditta KCI MEDICAL S.r.l. le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo della fornitura dalla cui analisi l'offerta aggiudicataria relativamente al Lotto 1 viene ritenuta non anomala;
- si propone pertanto di :
  - di prendere atto dei verbali sopra citati: dell'Ufficiale Rogante 2150 di Repertorio del 30.04.2010, n° 2237 di Repertorio del 28.03.11, della Commissione Giudicatrice n° 1 del 7 marzo 2011 e n° 2 del 21 marzo 2011;
  - di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta KCI MEDICAL S.r.l. di Assago (MI);
  - dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento per consentire l'avvio della fornitura in tempi brevi e comunque nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;



# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 5 di 6

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Ida GROSSI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

### DELIBERA:

- 1) di prendere atto dei verbali dell'Ufficiale Rogante 2150 di Repertorio del 30.04.2010, n° 2237 di Repertorio del 28.03.11, della Commissione Giudicatrice n° 1 del 7 marzo 2011 e n° 2 del 21 marzo 2011, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 1, 2, 3 e 4), relativi alla Procedura aperta per l'affidamento di fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara);
- 2) di procedere ad aggiudicazione definitiva nella Procedura aperta sopra citata a favore della ditta KCI MEDICAL di Assago (MI), in quanto ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito nel Disciplinare e Capitolato Speciale di gara, alle condizioni fissate nei documenti di gara e nella relativa offerta economica n° 2010/0412/eg/lb del 21.04.2010 (già allegata al verbale dell'Ufficiale Rogante n° 2237 di Repertorio del 28.03.11) per un importo complessivo della fornitura pari ad € 2.169.000,00 oltre IVA 20% (PARI AD € 433.800,00) per un totale complessivo di € 2.602.800 alle condizioni stabilite dagli atti di gara che qui si intendono richiamati;
- 3) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento in capo all'A.S.L. BI di Biella, per un periodo di 36 mesi pari, pari ad Euro 570.240,00 (Iva inclusa) verrà attribuito al conto 03.10.05.04 (Canoni per beni strumentali sanitari)– del budget assegnato alla S.O.C. Approvvigionamento di Beni rispettivi Bilanci di competenza come di seguito dettagliato:
  - Budget anno 2011: € 95.040,00;
  - Budget anno 2012: € 190.080,00;
  - Budget anno 2013 € 190.080,00;
  - Budget anno 2014 € 95.040,00;
- 4) di dare atto che l'inizio della fornitura è prevista, fatti salvi tutti gli obblighi di legge, con decorrenza 1 giugno 2011 per la durata di 36 mesi eventualmente espandibile di ulteriori 24 mesi secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale di gara ed a seguito di esito favorevole del previsto periodo di prova di 60 giorni;

# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 182 del 13-04-2011 - Pagina 6 di 6

- 5) di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di trasmettere copia del presente atto alle AA.SS.LL. e A.S.O. facenti parti dell'Area Sovrazonale per il recepimento dello stesso e gli adempimenti di competenza;
- 6) di dare mandato alla Struttura Organizzativa Complessa Approvvigionamento di Beni di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- 7) di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento per consentire l'avvio della fornitura in tempi brevi e comunque nel rispetto della normativa vigente;

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

### DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.



# AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 – 13900 Biella

*DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO*

DELIBERAZIONE N. 182 del 13-04-2011

Per approvazione

IL COMMISSARIO

f.to Dr.ssa Carla Peona





ALL TO 1

CPIA 14 +

Numero 2150 di Repertorio

**REPUBBLICA ITALIANA**

**VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA COMUNITARIA, IN APPLICAZIONE DEL D.LGVO 163/06, PER LA "FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELL'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, PER LA DURATA DI 36 MESI.**

L'anno Duemiladieci, il giorno 30 (Trenta) del mese di Aprile alle ore 10,18 presso l'Aula Magna sita al 3° Piano del Presidio Ospedaliero dell'A.S.L. "BI" di Biella, Via Caraccio n. 5, avanti a me Dr.ssa Attilia SQUILLARIO, Collaboratore Amministrativo, nella funzione di Ufficiale Rogante della Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, nominata con deliberazione n. 98 del 18.04.2007 e, come tale, autorizzata a rogare il presente atto assistita dai testimoni:

Rag. Elena MAESTRELLI, nata a Vercelli il 07.01.1965 e residente in Via Villaggio Primavera n. 17/B - Candelo (BI), Collaboratore Amministrativo dell'A.S.L. BI - Biella;

Sig.ra Marisa COMPAGNIN, nata a Candelo (BI) il 13.3.1964 e residente in Via Lombardia n. 14 - Biella (BI), Assistente Amministrativo dell'A.S.L. BI - Biella;

è comparsa la Dr.ssa Leila ROSSI, nata a Biella il 4.9.1963 e residente in Via M. Libertà, n. 7/B - Tollegno (BI), Direttore della S.O.C. Acquisizione e Gestione Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, Via Marconi n. 23, Partita I.V.A. n. 01810260024, titolata a presiedere la presente gara secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 34 del 26.01.2009.

Detto comparente, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono



Le

certa, attesta che:

-con deliberazione n. 110 del 23.02.2010, l'Azienda Sanitaria Locale BI ha indetto la gara a procedura aperta comunitaria, in applicazione del D. Lgvo 163/06, per la "Fornitura in noleggio di Sistemi Antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. Maggiore della Carità di Novara", per la durata di 36 mesi, approvando contestualmente i documenti di gara;

-il bando di gara è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per estratto sui quotidiani Italia Oggi Ed. Nazionale, MF/Milano Finanza Ed. Nazionale e Locale, e La Stampa Ed. Biella, integralmente sul sito dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI di Biella e nell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

-entro il termine perentorio stabilito nel Bando di Gara e, cioè le ore 16,00 del giorno 16.04.2010 prorogato al 26.04.2010 con nota in data 1.04.2010, Prot. n. 11174, sono pervenuti i plichi inviati dalle Ditte di seguito indicate e precisamente:

- 1) HILL ROM S.p.A - Rodano;
- 2) KCI MEDICAL S.r.l. - Assago (MI);
- 3) MEDI FM SERVICE S.r.l. - Volpiano (TO).

-ai plichi delle Ditte partecipanti alla gara viene assegnato un numero, come nell'ordine alfabetico sopra riportato;

-l'apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è fissata in data odierna alle ore 10,00, presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero dell'A.S.L. "BI", sita in Biella, Via Caraccio n. 5.

Il Presidente dichiara quindi che, in base a quanto stabilito dal Disciplinare di

Gara, all'interno del plico principale dovranno essere contenute le seguenti buste separate e distinte:

- A) la busta n. 1 recante la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativa alla gara a procedura aperta comunitaria, in applicazione del D. Lgvo 163/06, per la "Fornitura in noleggio di Sistemi Antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. Maggiore della Carità di Novara", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta dovrà contenere l'istanza di partecipazione alla gara, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Disciplinare di Gara;
- B) la busta n. 2 recante la dicitura: "DOCUMENTAZIONE TECNICA relativa alla gara a procedura aperta comunitaria, in applicazione del D. Lgvo 163/06, per la "Fornitura in noleggio di Sistemi Antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. Maggiore della Carità di Novara", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnica redatta secondo le indicazioni previste dal punto B) del Disciplinare di Gara;
- C) la busta n. 3 recante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA relativa alla gara a procedura aperta comunitaria, in applicazione del D. Lgvo 163/06, per la "Fornitura in noleggio di Sistemi Antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. Maggiore della Carità di Novara", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di Gara.



\*\*\*\*\*

Sono presenti, con facoltà di assistere alle operazioni di gara, i Sigg.:

- Dario VIANO e Christian CORSI della Ditta KCI MEDICAL S.r.l.;
- Roberto CERALE della Ditta HILL-ROM S.p.A.;
- Filippo CESTAGALLI, Legale Rappresentante della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l.;
- Avv. Alessandra Maria CARDELLA, che si dichiara legale di fiducia della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l.

\*\*\*\*\*

A questo punto il Presidente procede all'apertura dei plichi principali e all'esame della documentazione contenuta nella busta "Documentazione Amministrativa", dando atto quanto segue:

il plico principale della Ditta HILL ROM S.p.A. - Rodano (MI), (Numero 1), contiene tre buste:

la busta n. 3 recante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 2 recante la dicitura: "OFFERTA TECNICA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 1 recante la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che viene immediatamente aperta, al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta, che risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

A questo punto il Presidente procede ad aprire la busta dell'OFFERTA TECNICA e, verificata la regolarità formale del contenuto precisa che la documentazione tecnica verrà trasmessa dalla S.O.C. Approvvigionamento di Beni alla

Commissione Giudicatrice, per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente dichiara che la Ditta HILL ROM S.p.A. - Rodano, (Numero 1), avendo presentato regolarmente la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Disciplinare di Gara, viene ammessa al prosieguo della gara.

Si procede nell'apertura dei plichi principali e precisamente viene aperto il plico della Ditta KCI MEDICAL S.r.l. - Assago (MI), (Numero 2), che contiene tre buste:

la busta n. 3 recante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 2 recante la dicitura: "OFFERTA TECNICA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 1 recante la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che viene immediatamente aperta, al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta, che risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

A questo punto il Presidente procede ad aprire la busta dell'OFFERTA TECNICA e, verificata la regolarità formale del contenuto precisa che la documentazione tecnica verrà trasmessa dalla S.O.C. Approvvigionamento di Beni alla Commissione Giudicatrice, per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente dichiara che la Ditta KCI MEDICAL S.r.l. - Assago (MI), (Numero 2), avendo presentato regolarmente la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Disciplinare di Gara, viene ammessa al prosieguo della gara.

Si prosegue aprendo il plico principale della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. - Volpiano (TO), (Numero 3), che contiene tre buste:

la busta n. 3 recante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA", sigillata e

de 5 S. 13

controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 2 recante la dicitura: "OFFERTA TECNICA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

la busta n. 1 recante la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che viene immediatamente aperta, al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta.

Il Presidente rileva che la Ditta nell'istanza ha dichiarato di volersi avvalere dei requisiti tecnici della Ditta MEDI-H-HART di Peschiera Borromeo, ma dall'esame della documentazione è emerso che, per quanto riguarda il Lotto 1, la Ditta MEDI-H-HART di Peschiera Borromeo è in possesso dei requisiti tecnici richiesti per la partecipazione e pertanto l'avvalimento appare legittimo, mentre per quanto riguarda il Lotto 2 è emerso che il requisito tecnico non è posseduto né dalla ditta concorrente né dalla ditta ausiliaria MEDI-H-HART.

Pertanto il Presidente relativamente al Lotto 2 ritiene opportuno riservarsi per valutare la legittimità di un eventuale avvalimento parziale dei requisiti.

A questo punto il Presidente procede ad aprire la busta dell'OFFERTA TECNICA e verificata la regolarità formale del contenuto precisa che la documentazione tecnica verrà trasmessa, in seguito allo scioglimento della riserva sul Lotto 2, dalla S.O.C. Approvvigionamento di Beni alla Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di competenza.

Per tutto quanto sopra esposto, la Ditta MEDI FM SERVICE - Volpiano (TO), (Numero 3), viene ammessa per il Lotto 1 al prosieguo della gara, mentre per il Lotto 2 si procede ad ammissione con riserva per verificare la possibilità dell'avvalimento.

A questo punto il Presidente dà atto che è necessario procedere ad esperire le

*[Handwritten mark]*

*Se*  
*am*  
*ai* 6



operazioni di sorteggio ex art. 48 del Decreto Legislativo n. 163/06, in base al quale deve essere sorteggiato, per il controllo, un numero non inferiore al 10% arrotondato all'unità superiore delle offerte presentate e quindi, nella fattispecie concreta, deve essere estratta una Ditta.

A tal fine vengono scritti i nomi ed i numeri relativi alle Ditte su n. 3 foglietti, opportunamente piegati al fine di impedire la visione di quanto scritto sugli stessi e viene chiesto all'Avv. Alessandra Maria CARDELLA di procedere ad estrarne uno. L'Avv. Alessandra Maria CARDELLA estrae il biglietto con il numero 2 corrispondente alla Ditta KCI S.r.l. - Assago (MI).

Il Presidente dispone che la S.O.C. Approvvigionamento di Beni provveda ad eseguire la verifica sulle dichiarazioni rilasciate dalla Ditta estratta in merito al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica previsti dagli articoli n. 41 e 42 del D.Lg.vo 163/2006<sup>7</sup> e, esperita la suddetta verifica, provveda a comunicare alle Ditte partecipanti gli esiti e le modalità di prosecuzione delle operazioni di gara.

In ultimo il Presidente dichiara che tutta la documentazione relativa alla presente gara, nonché le buste contenenti le offerte economiche, sarà custodita a cura della S.O.C. Approvvigionamento di Beni.

A questo punto il Sig. Filippo CESTAGALLI, Amministratore Unico della Ditta MEDI FM-SERVICE S.r.l. chiede di poter rendere dichiarazioni a verbale.

Il Presidente acconsente.

Il Sig. Filippo CESTAGALLI scrive su un foglio le dichiarazioni delle quali viene data lettura ai presenti. Tali dichiarazioni vengono allegate al presente verbale quale parte integrante (Allegato n. 1).

\* \* \* \* \*

RE

Am. C

2006  
S. C.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho letto presenti i testi, questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero sette pagine intere e fino qui sulla ottava ai comparenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà e a verità  
La seduta si chiude alle ore 12,20.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Leila ROSSI)

*Leila Rossi*

I TESTIMONI

(Rag. Elena MAESTRELLI)

(Sig.ra Marisa COMPAGNIN)

COLLABORATORE AMM.VO

*Elena Maestrelli*

ASSISTENTE AMM.VO

*Marisa Compagnin*

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dr.ssa Attilio SQUILLARIO)

*Attilio Squillario*





Numero 2237 di Repertorio

**REPUBBLICA ITALIANA**

**VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA COMUNITARIA, IN APPLICAZIONE DEL D.LGVO 163/06, PER LA "FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELL'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, PER LA DURATA DI 36 MESI**

L'anno Duemilaundici, il giorno 28 (Ventotto) del mese di Marzo alle ore 09,45 presso la Sala Riunioni della Direzione Medica di Presidio posta nel Presidio Ospedaliero sito in Biella, Via Caraccio n. 5, Primo Piano, avanti a me Dr.ssa Attilia SQUILLARIO, Collaboratore Amministrativo Esperto, nella funzione di Ufficiale Rogante della Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, nominata con deliberazione n. 98 del 18.04.2007 e, come tale, autorizzata a rogare il presente atto assistita dai testimoni:

Rag. Elena MAESTRELLI, nata a Vercelli il 07.01.1965 e residente in Via Villaggio Primavera n. 17/B - Candelo (BI), Collaboratore Amministrativo dell'A.S.L. BI - Biella;

Sig.ra Marisa COMPAGNIN, nata a Candelo (BI) il 13.3.1964 e residente in Via Lombardia n. 14 - Biella (BI), Assistente Amministrativo dell'A.S.L. BI - Biella;

è comparsa la Dr.ssa Maria RAITERI, nata a Mirabello Monferrato il 24.05.1960 e residente in Via Verdi n. 29 - Canelli, Direttore della Struttura Complessa Approvvigionamento di Beni dell'Azienda Sanitaria Locale BI, Partita I.V.A. n. 01810260024, titolata a presiedere la presente gara secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 34 del 26.01.2009.

M

OK

du



La

Detto comparente, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa, attesta che:

-come risulta dal Verbale Repertorio n. 2150, che qui si richiama integralmente, nella seduta pubblica tenutasi il giorno 30.04.2010, si è proceduto ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte partecipanti ed è risultato che le ditte HILL ROM S.p.A., Rodano (MI), e KCI MEDICAL S.r.l., Assago (MI), sono state ammesse alle fasi successive della gara per entrambi i lotti, mentre la Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. - Volpiano (TO), è stata ammessa al prosieguo della gara per il Lotto 1 mentre per il Lotto 2 è stata ammessa con riserva per verificare la possibilità dell'avvalimento;

-successivamente è stata verificata la legittimità della proposta di avvalimento, presentata dalla Ditta MEDI FM SERVICE di Volpiano (TO), che è stata accolta e la suddetta Ditta è stata ammessa al prosieguo della gara anche per il Lotto 2;

-i controlli effettuati ex art. 48 D.L. n. 163 del 12.04.2006 in merito alla capacità tecnica contemplata al punto 9) dell'allegato A del Disciplinare di Gara della Ditta estratta nella seduta del 30.04.2010, e precisamente la Ditta KCI S.r.l. con Sede in Assago (MI), hanno dato esito positivo;

-con deliberazione dell'A.S.L. BI di Biella n. 280 del 29.04.2010, successivamente modificata con atto deliberativo n. 461 del 14.07.2010, è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle Ditte partecipanti alla procedura, che si è riunita nelle sedute del 25.08.2010 e 30.11.2010, redigendo appositi verbali, conservati agli atti dell'Ente, che qui si richiamano integralmente;

-a seguito di comunicazione di esclusione in data 3.12.2010 Prot. n. 36305, la Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. ha presentato informativa di ricorso, con nota del

M

Dr

Dr

Dr

7.12.2010;

-a seguito della suddetta informativa, la Stazione Appaltante ha provveduto a rinviare la procedura di apertura delle buste contenenti le offerte economiche • la Commissione Giudicatrice si è riunita, in data 13.12.2010, al fine di riaprire l'esame valutativo e approfondire gli aspetti tecnici sollevati dalla Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l.;

-con provvedimento n. 52 del 4.02.2011 il Commissario dell'A.S.L. BI ha provveduto, a seguito di dimissione di un componente, a rinominare la Commissione Giudicatrice, confermando il Presidente e i Componenti, ad eccezione del dimissionario, dando mandato, tra l'altro, di riesaminare gli atti di gara e l'attività espletata;

-la Commissione suddetta si è riunita nei giorni 7.03.2011 e 21.03.2011 per l'espletamento delle attività di competenza e l'attribuzione dei punteggi di qualità;


-al termine dell'espletamento delle attività di riesame la Stazione appaltante ha fissato l'apertura delle offerte economiche per la data odierna, avvisando le Ditte con nota fax del 24.03.2011.

Il Presidente prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, comunica ai presenti che la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Commissario n. 52 del 4.02.2011, ha ritenuto non idoneo il presidio mod. AIR EXPRESS della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. offerto per il LOTTO 1, sotto lotto B) e pertanto, essendo previsto nel Disciplinare di Gara l'aggiudicazione congiunta dei sotto lotti A) e B), la Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO 1.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura dei punteggi totali e normalizzati assegnati dalla Commissione Giudicatrice con Verbale n. 2 del

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



21.03.2011:

**LOTTO 1:**

-Ditta HILL-ROM: Punti 48,8 - Normalizzato a Punti 50;  
-Ditta KCI: Punti 44,2 - Normalizzato a Punti 45,286;

**LOTTO 2:**

-Ditta HILL-ROM: Punti 33;  
-Ditta KCI: Punti 50;  
-Ditta MEDI FM SERVICE: Punti 27,5.

\*\*\*\*\*

Sono presenti i Componenti della Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 52 del 04.02.2011, Sigg.:

-Sig. Massimo POLETTI - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto -  
Componente;  
-Sig.ra Veronica SCLANGUETTA - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto  
- Componente;  
-Sig.ra Anna RISO - Collaboratore Professionale Sanitario - Componente;  
-Sig.ra Roberta PESCE - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto -  
Componente.

Sono presenti, altresì, con facoltà di assistere alle operazioni di gara, i Sigg.:

- Enrico Federico Giovanni VITALI, Procuratore Speciale della Ditta KCI MEDICAL S.r.l.;
- Dario VIANO e Cristian CORSI della Ditta KCI MEDICAL S.r.l.;
- Roberto CERALE della Ditta HILL-ROM S.p.A.;
- Mariantonietta BRUNENGO;
- Filippo CESTAGALLI, Legale Rappresentante della Ditta MEDI FM

M

Handwritten signatures and a circular stamp.

- SERVICE S.r.l.;
- Avv. Alessandra Maria CARDELLA e Avv. Filippo TRAVIGLIA, Legali della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dopo aver dichiarato che la presente gara verrà aggiudicata, a Lotti separati, a favore della Ditta che avrà formulato, per ciascun Lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ed avrà ottenuto il punteggio più alto risultante da criteri di valutazione tecnico/qualitativa ed economica e ricordato inoltre che, per quanto riguarda i punteggi relativi all'offerta economica, verranno attribuiti 50 punti alla Ditta che avrà offerto il miglior costo totale della fornitura, come previsto dal Disciplinare di Gara e alle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali, procede ad aprire le buste contenenti l'offerta economica e attesta quanto segue:

LOTTO 1:

-la Ditta KCI MEDICAL S.r.l. offre l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 1.581.000,00= (Euro Unmilione cinquecentottantunomila/00);

-la Ditta HILL-ROM S.p.A. offre l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 1.755.000,00= (Euro Unmilione settecentocinquantacinquemila/00);

LOTTO 2:

-la Ditta HILL-ROM S.p.A. offre l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 435.750,00= (Euro Quattrocentotrentacinquemilasettecentocinquanta/00);

-la Ditta KCI MEDICAL S.r.l. offre l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 588.000,00= (Euro Cinquecentottantottomila/00);

-la Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. offre l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 443.625,00= (Euro Quattrocentoquarantatremilaseicentoventicinque/00).

M



Terminata l'apertura delle buste contenenti le offerte, alle ore 10,06, il Presidente dichiara temporaneamente sospesa la seduta al fine di calcolare, unitamente alla Commissione Giudicatrice, i punteggi relativi alla componente prezzo e i punteggi totali, dando atto che la Commissione procederà ad espletare tale attività nella presente sala.

\* \* \* \* \*

Alle ore 10,11, il Presidente riapre la seduta alla presenza di tutti i soggetti già richiamati nel presente verbale e, terminate le operazioni di calcolo, dichiara che i punteggi devono essere attribuiti come segue:

LOTTO 1:

-Ditta HILL-ROM S.p.A. - Rodano (MI):

Punteggio Tecnico 50 + Punteggio Economico 45,04 = Punteggio complessivo 95,04.

-Ditta KCI MEDICAL S.r.l. - Assago (MI):

Punteggio Tecnico 45,286 + Punteggio Economico 50 = Punteggio complessivo 95,286.

LOTTO 2:

-Ditta HILL-ROM S.p.A. - Rodano (MI):

Punteggio Tecnico 33 + Punteggio Economico 50 = Punteggio complessivo 83.

-Ditta KCI MEDICAL S.r.l. - Assago (MI):

Punteggio Tecnico 50 + Punteggio Economico 37,05 = Punteggio complessivo 87,05.

-MEDI FM SERVICE S.r.l. - Volpiano (TO):

Punteggio Tecnico 27,5 + Punteggio Economico 49,11 = Punteggio complessivo 76,61.

M

lm  
K  
G  
P  
22

\*\*\*\*\*

Dopo aver letto ai presenti l'attribuzione dei punteggi, il Presidente formula la seguente graduatoria:

LOTTO 1


Ditta KCI MEDICAL S.r.l., con Sede in Assago (MI), che ha offerto l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 1.581.000,00 (Euro Unmilione cinquecentottantunomila/00) ed ha, altresì, raggiunto il punteggio di punti 95,286, prima classificata, aggiudicataria provvisoria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la procedura aperta per l'Affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" per la durata di 36 mesi;

Ditta HILL-ROM S.p.A., con Sede in Rodano (MI), che ha offerto l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 1.755.000,00 (Euro Unmilione settecentocinquantacinquemila/00) ed ha, altresì, raggiunto il punteggio di punti 95,04, seconda classificata;

LOTTO 2

Ditta KCI MEDICAL S.r.l., con Sede in Assago (MI), che ha offerto l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 588.000,00 (Euro Cinquecentottantottomila/00) ed ha, altresì, raggiunto il punteggio di punti 87,05, prima classificata, aggiudicataria provvisoria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la procedura aperta per l'Affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. dell'Area di Coordinamento Sovrazonale "NO" per la durata di 36 mesi;

Ditta HILL-ROM S.p.A., con Sede in Rodano (MI), che ha offerto l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 435.750,00 (Euro Quattrocentotrenta-

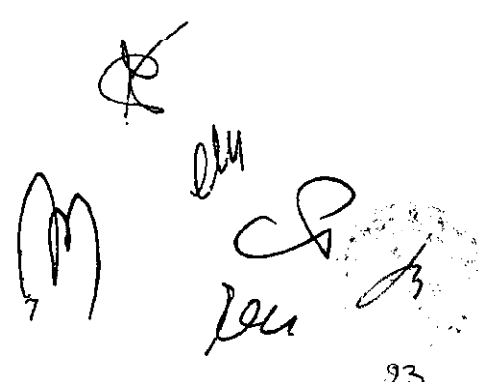Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large 'M' and several other scribbles.

cinquemilasettecentocinquanta/00) ed ha, altresì, raggiunto il punteggio di punti 83, seconda classificata;

Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l., con Sede in Volpiano (TO), che ha offerto l'importo complessivo per tre anni pari ad Euro 443.625,00 (Euro Quattrocentoquarantatremilaseicentoventicinque/00) ed ha, altresì, raggiunto il punteggio di punti 76,61, terza classificata.

Il Presidente dichiara infine che la documentazione relativa alla presente gara a procedura aperta verrà trasmessa alla Direzione Generale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti e successivamente conservata presso la S.O.C. Approvvigionamento di Beni.

Il Presidente dichiara, altresì, che il presente verbale sarà vincolante per l'Azienda solo dopo la verifica della congruità dell'offerta. e l'approvazione della delibera di aggiudicazione definitiva.

Si allegano le offerte economiche per i LOTTI n. 1 e n. 2 presentate dalla Ditta:

-KCI MEDICAL S.r.l., con Sede in Assago (MI) (Allegato n. 1 e n. 2).

\* \* \* \* \*

Prima del termine della seduta, il Rappresentante Legale della Ditta MEDI FM SERVICE S.r.l., Sig. Filippo CESTAGALLI chiede di poter rendere a verbale alcune dichiarazioni.

Il Presidente acconsente e il Sig. Filippo CESTAGALLI scrive su apposito foglio le dichiarazioni che intende verbalizzare e lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ai presenti e chiede che sia allegato in parte integrante e sostanziale al presente verbale (Allegato n. 3).

\* \* \* \* \*

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho letto presenti i testi, questo atto dattiloscritto da

M

RM  
Joc CF





persona di mia fiducia su numero otto pagine intere e fino qui sulla nona ai  
comparenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà e a verità.

La seduta si chiude alle ore 10,21.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Maria RAITERI)

I TESTIMONI

(Rag. Elena MAESTRELLI)

(Sig.ra Marisa COMPAGNIN)

COLLABORATORE AMM.VO

ASSISTENTE AMM.VO

*Elena Maestrelli*

*Marisa Compagnin*

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dr.ssa *Attilia* SOUILLARIO)

**SCHEMA D'OFFERTA N. 2010/0412/eg/lb del 21/04/2010**

Lotto 1 codice CIG: 0440098C58

	COSTO GIORNATA NOLEGGIO (a)	GIORNATE/ ANNO Area "NO" (b)	GIORNATE periodo: 3 anni (c)	GIORNATE periodo: ulteriori 2 anni (d)	GIORNATE periodo: 3 + 2 anni (c+d)	IMPORTO FORNITURA ANNUO Area "NO" $E=(a \times b)$	IMPORTO FORNITURA 3 ANNI Area "NO" $F=(a \times c)$	IMPORTO FORNITURA ulteriori 2 ANNI Area "NO" $G=(a \times d)$	VALORE COMPLESSIVO 3 + 2 ANNI (F+G)
Pressione Alternata e/o bassa pressione d'appoggio									
AirWorks™ Sure Sotto lotto A	€ 4,00	80.000	240.000	160.000	400.000	€ 320.000,00	€ 960.000,00	€ 640.000,00	€ 1.600.000,00
Proficare® Sotto lotto B	€ 9,00	23.000	69.000	46.000	115.000	€ 207.000,00	€ 621.000,00	€ 414.000,00	€ 1.035.000,00
		103.000	309.000	206.000	515.000	€ 527.000,00	€ 1.581.000,00	€ 1.054.000,00	€ 2.635.000,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1</b>									
							<b>€ 1.581.000,00</b>		

**NOTA BENE:**

I prezzi proposti non potranno essere superiori a quelli risultanti da eventuali convenzioni stipulate da CONSIP per forniture di pari oggetto. Il prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i costi necessari per a fornitura e gestione del servizio, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico, sanificazione e di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto dal Capitolato Speciale.

**QUOTAZIONI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PREZZO ai fini dell'aggiudicazione di gara:**

- percentuale dell'IVA
- costo giornaliere di noleggio per le varie tipologie
- per tutti i sistemi proposti, quantificazione della quota di riscatto dopo un periodo di noleggio continuativo di 8 mesi (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione per l'eventuale acquisto di apparecchiature ricondizionate (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione del servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per sistemi di proprietà delle singole Aziende (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione giornata/noleggio per sistemi antidecubito per grandi obesi (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione giornata/noleggio per sistemi antidecubito pediatrici (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione unitaria per eventuale acquisto di cuscini antidecubito (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- indicare il numero di Repertorio dei Dispositivi Medici e il relativo codice CND;

Il firmatario

**KCI Medical Srl**

*Amministratore Delegato*

Leonardo Borghesio

Leonardo Borghesio - Amministratore Delegato



**QUOTAZIONI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PREZZO al fini dell'aggiudicazione di gara:**

1. Percentuale I.V.A. 20%
  
2. Per i sistemi a Pressione Alternata LOTTO 1 - Sottolotto A e B, quantificazione della quota di riscatto dopo un periodo di noleggio continuativo di 8 mesi:
 

Lotto 1 - Sottolotto A - sistema antidecubito AirWorks® Sure	€ 1.600,00 (IVA 20% esclusa)
Lotto 1 - Sottolotto B - sistema antidecubito Proficare®	€ 4.200,00 (IVA 20% esclusa)
  
3. Quotazione per l'eventuale acquisto di apparecchiature ricondizionate per le tipologie richieste:
 

Lotto 1 - Sottolotto A sistema antidecubito AirWorks® Sure	€ 2.600,00 (IVA 20% esclusa)
Lotto 1 - Sottolotto B sistema antidecubito Proficare®	€ 6.400,00 (IVA 20% esclusa)
  
4. Quotazione del servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per i sistemi di proprietà delle singole Aziende:
 


Lotto 1 - Sottolotto A sistema antidecubito AirWorks® Sure	€ 15,00 (IVA 20% esclusa)
Lotto 1 - Sottolotto A sistema antidecubito AirWorks® Sure	€ 50,00 (IVA 20% esclusa)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Lotto 1 - Sottolotto B sistema antidecubito Proficare® Lotto 1 - Sottolotto B sistema antidecubito Proficare®:	Sanificazione del Telo di copertura Sanificazione completa (telo+materasso) del Sistema antidecubito	€ 15,00 (IVA 20% esclusa) € 50,00 (IVA 20% esclusa)
	Sistema antidecubito AtmosAir™ 4000	€ 10,50 (IVA 20% esclusa)
5. Quotazione giornata/noleggio per i sistemi antidecubito per grandi obesi:	Sistema antidecubito First Step™ Select	€ 9,00 (IVA 20% esclusa)
6. Quotazione giornata/noleggio per i sistemi antidecubito pediatrici:	Sistema antidecubito AtmosAir™ 300	€ 550,00 (IVA 20% esclusa)
7. Quotazione unitaria per acquisto di cuscini antidecubito:		


  
 29

INDICAZIONE DEL NUMERO DI REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI E IL RELATIVO CODICE CND DEI SISTEMI ANDITECUBITO OFFERTI:

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE CND	NUMERO DI REPERTORIO
AirWors™ Sure	Y033306	108345/R
Proficare®	Y033306	108384/R
AtmosAir™ 4000	Y033306	108361/R
RIK™ MRS	Y033399	114706/R
First Step™ Select	Y033306	108361/R
AtmosAir™ 300	Z12030799	108319/R

Il firmatario



Leonardo Borghesio – Amministratore Delegato

**KCI Medical Srl**

Amministratore Delegato

Leonardo Borghesio



31

**SCHEMA D'OFFERTA N. 2010/0412/eg/lb del 21/04/2010**

Lotto 2 codice CIG: 0440100DFE

	COSTO GIORNATA NOLEGGIO (a)	GIORNATE/ ANNO Area "NO" (b)	GIORNATE periodo: 3 anni (c)	GIORNATE periodo: ulteriori 2 anni (d)	GIORNATE periodo: 3 + 2 anni (c+d)	IMPORTO FORNITURA ANNUO Area "NO" $E=(a \times b)$	IMPORTO FORNITURA 3 ANNI Area "NO" $F=(a \times c)$	IMPORTO FORNITURA ulteriori 2 ANNI Area "NO" $G=(a \times d)$	VALORE COMPLESSIVO 3 + 2 ANNI (F+G)
Therakair® Visio™ Cessione Aria	€ 1120	17.500	52.500	35.000	87.500	€ 196.000,00	€ 588.000,00	€ 392.000,00	€ 980.000,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2</b>							<b>€ 588.000,00</b>		

14/



**NOTA BENE:**

I prezzi proposti non potranno essere superiori a quelli risultanti da eventuali convenzioni stipulate da CONSIP per forniture di pari oggetto. Il prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i costi necessari per la fornitura e gestione del servizio, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico, sanificazione e di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto dal Capitolato Speciale.

**QUOTAZIONI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PREZZO ai fini dell'aggiudicazione di gara:**

- percentuale dell'IVA
- costo giornaliero di noleggio per le varie tipologie
- per tutti i sistemi proposti, quantificazione della quota di riscatto dopo un periodo di noleggio continuativo di 8 mesi (di tale quotazione non si terrà conto al fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione per l'eventuale acquisto di apparecchiature ricondizionate (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione del servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per sistemi di proprietà delle singole Aziende (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione giornata/noleggio per sistemi antidecubito per grandi obesi (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione giornata/noleggio per sistemi antidecubito pediatrici (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- quotazione unitaria per eventuale acquisto di cuscini antidecubito (di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione dell'elemento prezzo);
- indicare il numero di Repertorio dei Dispositivi Medici e il relativo codice CND;

Il firmatario

**KCI Medical Srl**

*Amministratore Delegato*

Leonardo Borghesio

Leonardo Borghesio – Amministratore Delegato

CP

**QUOTAZIONI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PREZZO ai fini dell'aggiudicazione di gara:**

1. Percentuale I.V.A. 20%
2. Quotazione per l'eventuale acquisto di apparecchiature ricondizionate per le tipologie richieste:  
Sistema antidecubito Therakair® Visio € 9.500,00 (IVA 20% esclusa)
3. Quotazione del servizio di sanificazione (compreso il ritiro e la consegna) per i sistemi di proprietà delle singole Aziende:  
Sistema antidecubito Therakair® Visio: Sanificazione del Telo di copertura € 25,00 (IVA 20% esclusa)  
Sistema antidecubito Therakair® Visio: Sanificazione completa (telo+materasso)del Sistema antidecubito € 75,00 (IVA 20% esclusa)
4. Quotazione giornata/noleggio per i sistemi antidecubito per grandi obesi:  
Sistema antidecubito AtmosAir™ 4000 € 10,50 (IVA 20% esclusa)
5. Quotazione giornata/noleggio per i sistemi antidecubito pediatrici:  
Sistema antidecubito First Step™ Select € 9,00 (IVA 20% esclusa)
6. Quotazione unitaria per acquisto di cuscini antidecubito  
Sistema antidecubito AtmosAir™ 300 € 550,00 (IVA 20% esclusa)


SP

AK

**INDICAZIONE DEL NUMERO DI REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI E IL RELATIVO CODICE CND DEI SISTEMI ANDITECUBITO OFFERTI:**

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE CND	NUMERO DI REPERTORIO
Thetakai® Visio	Y033306	114292/R
AtmosAir™ 4000	Y033306	108351/R
Rk™ MRS	Y033399	114706/R
First Step™ Select	Y033308	108361/R
AtmosAir™ 300	Z12030799	108319/R

Il firmatario



**KCI Medical Srl**

Amministratore Delegato  
Leonardo Borghese - Amministratore Delegato  
Leonardo Borghese





all 28/3/2011

edil-FA-Service S.r.l. dichiara di riservarsi  
più ampia iniziativa a propria tutela, facendolo  
tutti presenti di aver inviato a questa Ammini-  
strazione apposita comunicazione nella giornata del  
01/03/2011 e precisando che la propria partecipazione  
questa seduta non comporta acquiescenza rispetto  
alle decisioni assunte da questa Amministrazione


14 Dec

Askyo Gendun

7





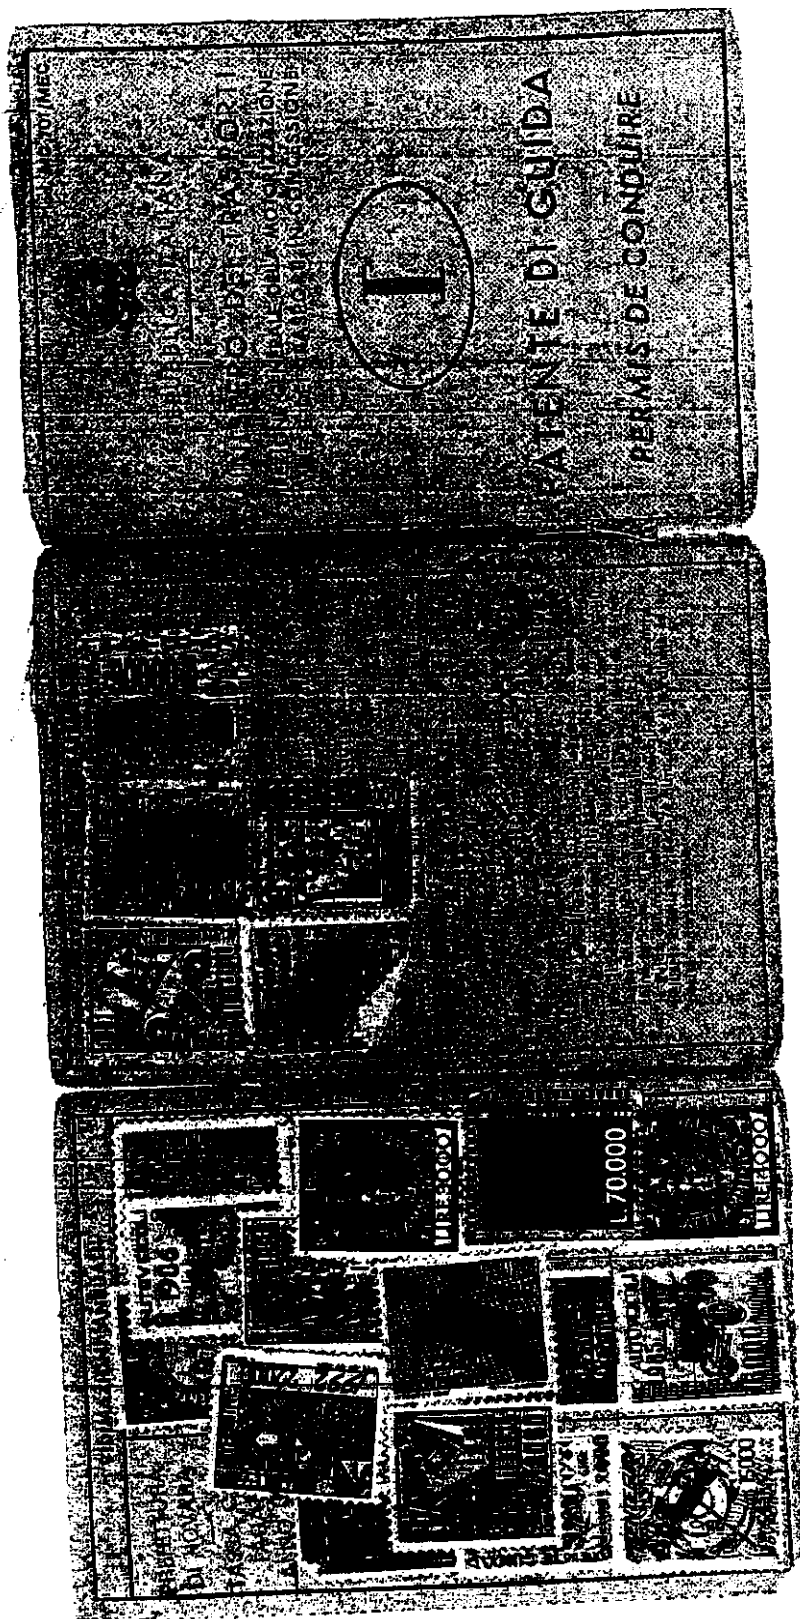

CS

39



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**S.O.C. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI**

Direttore: Dott.ssa Maria Raiteri  
Ospedale degli Infermi  
Via Caraccio, 5/a - 13900 Biella  
Tel. 015-3503593-449  
elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI  
SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. dell'AREA DI  
COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" per la durata di 36 mesi.**

**VERBALE N° 1**

**Commissione giudicatrice nominata con Delibera 52 del 04.02.2011**

In data 07 marzo 2011 alle ore 9,55 presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio, 5 ha inizio la prima seduta della Commissione giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura Aperta in oggetto.

Premesso che:


1. con delibera del Direttore Generale n° 461 del 14.07.2010 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto così composta:
  - Dott.ssa Maria Raiteri- Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni - Presidente;
  - Sig. Massimo Poletti - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
  - Sig.ra Veronica Scianguetta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
  - Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
  - Sig.ra Roberta Pesce - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
  - Sig.ra Claudia Gatta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
  - Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni; Segretaria verbalizzante.
2. con delibera n° 52 del 04.02.2011 il Commissario nel prendere atto delle dimissioni, da componente, dalla Sig.ra Claudia Gatta, ha:
  - a) proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto confermando in qualità di Presidente la Dott.ssa Maria Raiteri- Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni così come i seguenti componenti rimasti:
    - Sig. Massimo Poletti - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
    - Sig.ra Veronica Scianguetta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
    - Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
    - Sig.ra Roberta Pesce - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

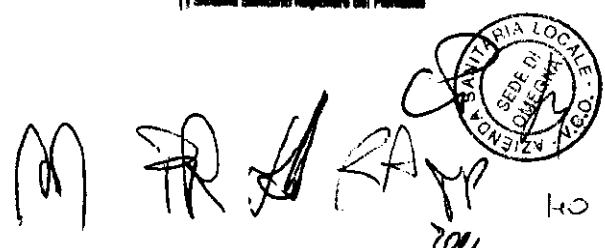





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

▪ Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni: Segretaria verbalizzante.

- b) invitato la Commissione così costituita a confermare o meno, dopo attento esame, gli atti istruttori (verbali) sin qui espletati;
- c) invitato altresì la Commissione ad esaminare nuovamente la posizione della società MEDI FM alla luce delle osservazioni mosse con nota del 07.12.2010 ed ancora da riesaminare.

Tutto ciò premesso si dà atto che in data odierna la nuova Commissione Giudicatrice è presente al completo.

La Commissione Giudicatrice prende atto di tutte le operazioni effettuate dalla precedente Commissione Giudicatrice e contenute nei seguenti verbali allegati in copia al presente a parte integrante e sostanziale:

1. verbale n° 1 del 25.08.2010 della Commissione Giudicatrice nominata con delibera del Direttore Generale n° 461 del 14.07.2010: con il quale l'esame istruttorio veniva affidato ad una sottocommissione (composta dagli stessi componenti escluso il Presidente);
2. verbale n° 2 del 30.11.2010 della Commissione Giudicatrice nominata con delibera del Direttore Generale n° 461 del 14.07.2010: con il quale la Commissione Giudicatrice, su relazione istruttorio della sottocommissione, procede all'attribuzione dei punteggi qualitativi;
3. verbale del 13.12.2010 con il quale il Presidente della Commissione Giudicatrice comunicava l'informativa di ricorso da parte della ditta MEDI FM avverso il giudizio di non idoneità dell'offerta presentata per il lotto 1 (sottolotto b), espresso nella seduta del 30.11.2010 e la Commissione all'unanimità decideva di riaprire l'esame valutativo e di rinviare l'approfondimento degli aspetti tecnici sollevati dalla ditta MEDI FM SERVICE a successive sedute.

Dopo attento esame la nuova Commissione Giudicatrice approva tutti gli adempimenti istruttori affidati alla sottocommissione, compresa la prova visione, contenuti nei verbali richiamati.

Per quanto riguarda le valutazioni/giudizi sulle offerte tecniche contenute nella relazione allegata al verbale n° 2 del 30.11.2010, contenente altresì la relazione dell'Ing. Alberto Petti Responsabile della S.O.S. Ingegneria Clinica dell'A.S.L. BI di Biella, la Commissione Giudicatrice, nel prenderne atto, decide all'unanimità di procedere ad una rivalutazione autonoma delle offerte tecniche presentate da tutte le ditte partecipanti ed in particolare di riesaminare la posizione della ditta MEDI FM alla luce delle osservazioni da questa mosse con nota del 07.12.2010 che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale.

Prima però di procedere a detta valutazione la Commissione Giudicatrice ritiene fondamentale evidenziare gli obiettivi della gara contenuti negli atti di gara ed in particolare nel capitolato tecnico.

La gara è suddivisa in due lotti distinti: Lotto 1) e Lotto 2).

Il lotto 1) riguarda i materassi a Pressione alternata e/o bassa pressione d'appoggio a sua volta diviso in due sotto lotti: sotto lotto A) e sotto lotto B)

Il lotto 2) riguarda i materassi a cessione d'aria.

La Commissione ritiene che la differenziazione dei prodotti richiesti in fornitura nei due lotti principali sopra indicati e, relativamente al lotto 1) nei due sotto lotti A e B, trovi motivazione nell'esigenza di differenziare il parco attrezzature su due diversi livelli qualitativi anche in relazione alle diverse criticità dei pazienti da trattare ed in riferimento ai diversi punteggi (score) della "Scala di Braden":

- Materassi a pressione alternata, con differenziazione dei due sotto lotti A e B, facenti riferimento a pazienti con "score" di rischio lesione rispettivamente medio e alto (Lotto 1);
- Materassi a cessione d'aria per la gestione di pazienti particolarmente complessi (Lotto 2).

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp.]*

**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Questo, nell'ottica di fornire al personale infermieristico strumenti con diversa tecnologia/qualità (ed implicitamente di diverso costo) per poter gestire le differenti situazioni clinico/assistenziali tecnicamente ed economicamente più adeguate.

In particolare per il lotto 1) i due sotto lotti A e B risultano differenti per alcune caratteristiche, con gradi di importanza differenti, individuate fra quelle essenziali dal Capitolato Speciale (punti A della scheda tecnica Allegato 1) e riassunte nella seguente tabella:

Caratteristica	Sottolotto A	Sottolotto B
Portata terapeutica (Punto A-11)	Non inferiore a 130 kg	Non inferiore a 150 kg
PRESSIONE DI CONTATTO in ogni punto del corpo INFERIORE ALLA POC (32 mmHg) (Punto A-12)	Per almeno il 50% del ciclo indipendentemente dal peso e dalla posizione del paziente	Per almeno il 60% del ciclo indipendentemente dal peso e dalla posizione del paziente
Automatismi di adattamento al paziente (Punto A-14)	Dotato di automatismo di funzionamento (interattivo)	Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombosacrale. Tale sensore deve permettere un adattamento continuo in funzione del peso e del posizionamento del paziente per mantenere basse pressioni di appoggio anche con paziente in posizione seduta.
Altezza della parte dinamica del materasso (Punto A-18)	Almeno 10 cm	Almeno 14 cm
Garanzia di uno scarico delle pressioni di contatto diversificato per la zona dei talloni (punto A-15)	Non richiesto	Richiesto
Pressione statica nella sezione del capo (Punto A-16)	Non richiesto	Richiesto

La differenziazione dei due sottolotti passa fondamentalmente per una caratteristica, fra quelle sopra richiamate, ovvero quella prevista al punto A-14.

Tale caratteristica infatti, prevista in modo differenziato nei due sottolotti, individua due segmenti merceologici profondamente diversi:

1. il primo, previsto nel sottolotto A, adatto per pazienti a medio rischio, dotato di automatismo di funzionamento del sistema, operante su tutta la superficie antidecubito e semplicemente in grado di adattarsi a pazienti di peso differente "accogliendoli" al meglio anche a partire da una regolazione di "comfort" effettuata dall'operatore;
2. il secondo, previsto nel sottolotto B, molto più complesso, adatto per pazienti a rischio medio/alto, prevede la rilevazione, tramite sensori interni, della pressione esercitata dal paziente a livello della zona lombosacrale, zona più critica del corpo, per meglio adattarsi, mediante compensazioni nel gonfiaggio, ai cambi di posizione ed in particolare a quella semiseduta e seduta evitando assolutamente la condizione di contatto con la parte statica del materasso considerato che il carico esercitato su una zona del materasso varia in base alla posizione assunta dal paziente come meglio rappresentato nella figura sottostante.

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

PR M A RA T  
Zan  
42



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE


Via Marconi, 23 - 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

#### ESEMPI DI CARICO SULLA COLONNA VERTEBRALE

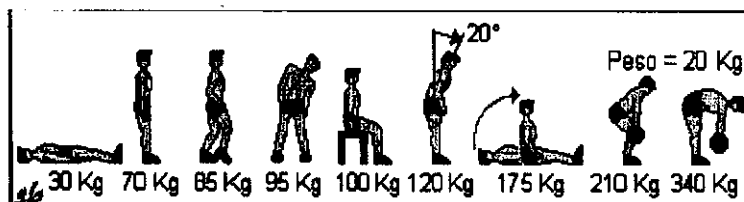

tab. 1

Forza agente sulla vertebra L3 in diverse situazioni in un soggetto di circa 70 Kg di peso  
(figura estratta sui dati della tabella descrittiva in "Basi biomeccaniche nella prevenzione dei danni  
alla colonna lombare durante esercizio fisico - Revisione della bibliografia esistente" di Zatsiorski V.M.  
e Sazonov V.P. - Atleticastudi n. 5 1988)

Alla luce delle considerazioni sopra espresse la Commissione Giudicatrice da inizio alla valutazione delle offerte tecniche presentate da tutte le ditte partecipanti.

La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura di tutti i verbali in premessa richiamati ed in considerazione del fatto che all'istruttoria eseguita dalla Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n° 461 del 14.07.2010 avevano partecipato tutti i componenti, fatta eccezione per il Presidente della nuova Commissione Giudicatrice oggi riunita, all'unanimità stabilisce:

1. relativamente al Lotto 1) sotto lotto A e Lotto 2): di confermare i giudizi in capo alle ditte HILL ROM, KCI e MEDI FM, contenuti nel verbale n° 2 del 30.11.2010 della precedente Commissione Giudicatrice e formulati sulla base della documentazione presentata e delle prove visioni effettuate;
2. relativamente al lotto 1) sotto lotto B: di confermare i giudizi espressi nel verbale n° 2 già richiamato, limitatamente alle ditte KCI e HILL ROM mentre per quanto riguarda la ditta MEDI FM di procedere al riesame alla luce dell'informativa di ricorso della ditta MEDI FM del 07.12.2010.

## LOTTO 1

### SOTTO LOTTO A

#### Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste a pena di esclusione.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata e dalla prova visione, tutte le ditte risultano rispondere ai requisiti richiesti previsti dal p.to A-1 al punto A-10 della scheda tecnica All.to 1.

#### Caratteristiche e prestazioni tecniche qualitative oggetto di valutazione.

Di seguito si espongono i giudizi della Commissione che vengono assegnati secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara".



www.regione.piemonte.it/sanite



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Handwritten signatures and a circular stamp of the Azienda Sanitaria Locale di Biella.



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.asibi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

	LOTTO 1 Sotto lotto A	Modalità di attribuzione	Punti 25
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale e nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13

**Ditta Hill - Rom: MOD. PRIMO**

Presenta un sensore sotto il bacino che rileva costantemente la pressione di gonfiaggio garantendo la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo.

Parte statica: 3 cm; parte dinamica 13 cm.

**Ditta KCI: MOD. AIR WORK SURE**

Dispone anch'esso di un sensore posizionato a livello del bacino del paziente garantendo una miglior gestione dello scarico dei pesi in posizione seduta per il 60% del ciclo.

Parte statica: 7 cm.; parte dinamica: 14 cm.;

**Ditta MEDI FM: MOD AIR CONCEPT HC 04**

Risponde alle caratteristiche minime essenziali richieste (50%/ciclo).

Parte statica: 5cm.; parte dinamica: 13 cm.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: OTTIMO;**

**KCI: BUONO;**

**MEDI-FM: SUFFICIENTE;**

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
-----	---	--	---

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di consegna e ritiro del sistema (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

**Ditta HILL ROM** ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con problemi respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione, gratuitamente per numero di giornate 150.
- sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Il Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- un sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

Ditta KCI ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- Indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° stadio per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

Ditta MEDI FM nella documentazione tecnica non risultano presenti proposte di miglioria.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare.

Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

HILL-ROM: OTTIMO;  
KCI: OTTIMO;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Tutti i sistemi presentati dispongono di una portata terapeutica sovrapponibile che si ritiene di buon livello.

Ditta HILL ROM: 150 Kg.

Ditta KCI: 153 Kg.


Ditta MEDI FM: 150 Kg.

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

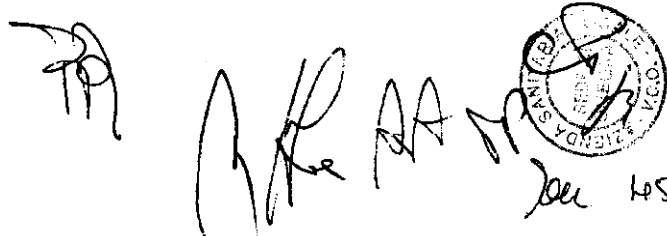



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

HILL-ROM: BUONO;

KCI: BUONO;

MEDI-FM: BUONO;

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

Ditta Hill Rom dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x200);

Ditta KCI dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 e da 90);

Ditta MEDI FM dispone di un sola misura di materassi (cm. 87x205);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

Per le motivazioni sopra esposte il parametro in esame è completamente soddisfatto in tutte le sue voci per tutte le ditte.

## LOTTO 2

### Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste a pena di esclusione.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata e dalla prova visione, tutte le ditte risultano rispondere ai requisiti richiesti previsti dal p.to A-1 al punto A-20 della scheda tecnica All.to 2.

### Caratteristiche e prestazioni tecniche qualitative oggetto di valutazione.

Di seguito si espongono i giudizi della Commissione che vengono assegnati secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara".

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Relativamente a detto lotto, visto le affinità tecniche la Commissione Giudicatrice decide di unificare i parametri B-1 E B-2 in un unico criterio sommatorio dei due.

LOTTO 2		Punti 50	Criterio motivazionale
B-1	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie	14	Verrà valutato il maggior indice MVTR e la maggiore superficie di distribuzione dell'aria assegnando il punteggio con l'attribuzione dei seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
B-2	Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	12	Verrà valutata l'efficacia del presidio, in termini di prevenzione della macerazione cutanea (Allegato 4) in soggetti con lesioni, o gestione del paziente ad alto rischio attraverso la tecnologia utilizzata e studi clinici da presentare in lingua italiana attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.

**Ditta HILL-ROM: MOD. CLINACTIVE MCM**

Presenta un MVTR di 450/gr/m<sup>2</sup>/24h

**Ditta KCI: MOD. THERAKAIR**

Presenta un indice MVTR pari a 10.000/gr/m<sup>2</sup>/24h;

**Ditta MEDI-FM: MOD. AUTO AIR SELECT**

Presenta un indice MVTR di 557/gr/m<sup>2</sup>/24h;

I materassi presentati dalle ditte MEDI FM SERVICE e KCI MEDICAL rientrano nella tipologia analizzata dalla "Revisione" della Cochrane che definisce come valido, nella gestione delle lesioni cutanee, l'utilizzo dei materassi a cessione d'aria.

Nel sistema presentato dalla ditta KCI la maggior distribuzione dell'aria è garantita dalla traspirazione dell'aria su tutta la superficie del materasso o del materiale di cui il telo di copertura è costituito. E' inoltre da rilevare che il prodotto Therakair dispone della modalità denominata pulsoterapia che migliora la gestione del paziente ad alto rischio (come da studio presentato).

Nel materasso presentato dalla ditta MEDI FM SERVICE la superficie di distribuzione dell'aria non risulta omogenea su tutta la superficie del materasso ma è collegata ai fori di fuoriuscita posizionati agli estremi laterali di ogni cella ed il telo di copertura, non chiudendo completamente il materasso, provoca una maggiore dispersione (anche verso il basso) dell'aria.

Per quanto riguarda il prodotto presentato dalla ditta HILL ROM, lo stesso viene definito dalla ditta come "sistema a microcessione d'aria"; si reputa che la tecnologia utilizzata per tale sistema, spiegata nella fase dimostrativa, sia adeguata per gestire la prevenzione della macerazione cutanea pur in assenza di studi clinici.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

HILL-ROM: SUFFICIENTE;  
KCI: OTTIMO;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
-----	---	----	--

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 13000 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503546  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), , modalità di consegna e ritiro del sistema (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

Ditta HILL ROM ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con problemi respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione, gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

Ditta KCI ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi o orecchio per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;

Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

Ditta MEDI FM nelle documentazione tecnica non risultano presenti proposte di miglioria.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte e tre le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare.

Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

HILL-ROM: OTTIMO;  
KCI: OTTIMO;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "RA" and "MP".





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	Verrà valutata congiuntamente l'altezza della parte dinamica, l'altezza della parte statica attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
-----	--------------------------------------	---	---

La valutazione dell'altezza della parte dinamica e della parte statica è indicativa della capacità del presidio di mantenere in sicurezza il paziente in caso di mancanza di energia elettrica.

**Ditta HILL ROM:** il sistema è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.

**Ditta KCI:** il sistema presenta un sistema dotato da una parte statica di 8 cm ed una parte dinamica di 16 cm.

**Ditta MEDI-FM:** presenta un sistema dotato di una parte statica di 4 cm e parte dinamica di 20 cm.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM:** SUFFICIENTE;

**KCI:** OTTIMO;

**MEDI-FM:** SUFFICIENTE;

B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.
-----	--	---	---

Durante la prova visione sono state prese in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

**Allarmi:** tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

**Gamma dei materassi:**

Tutte le ditte hanno dichiarato la disponibilità dei materassi (come da richiesta specifica dei requisiti essenziali).

**Sistema aggancio al letto:** tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

Per le motivazioni sopra riportate il parametro in esame è considerato soddisfatto in tutte le sue voci per tutte le ditte.

## LOTTO 1

### SOTTO LOTTO B

#### Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste a pena di esclusione.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata e dalla prova visione, le ditte HILL ROM e KCI risultano rispondere ai requisiti richiesti previsti dal p.to A-1 al punto A-21 della scheda tecnica All.to 1.

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Handwritten signatures and initials: RA, AB, RA, PP, J... and a circular stamp with the number 49.



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi. 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

La Commissione Giudicatrice relativamente al sistema proposto dalla ditta MEDI FM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) prende atto del giudizio espresso dalla precedente Commissione Giudicatrice che di seguito si riporta:

\* ..... Relativamente a questo Sotto Lotto B, il modello presentato dalla ditta MEDI FM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso. Tale caratteristica non risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara, ed in particolare dalla caratteristica espressa al punto A-14 (Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale) che richiede la possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale). ...."

La Commissione prende altresì atto dei rilievi mossi dalla ditta MEDI FM nell'informativa di ricorso del 07.12.2010 in particolare dell'aspetto riguardante la funzione del sensore che la ditta sostiene essere " ..... proprio quella di diminuire la pressione a livello lombo-sacrale nel caso in cui il paziente si trovi in posizione semiseduta e riequilibrarla su tutta la superficie delle celle in modo da mantenere livelli di pressione e di contatto sempre al di sotto dei 32 mm Hg in ogni punto, per almeno il 70% dell'intero ciclo di lavoro ....."

La Commissione nel riesaminare la posizione della ditta MEDI FM all'unanimità esprime le seguenti considerazioni.

La presenza di un sensore nella zona lombosacrale serve a garantire la sicurezza del paziente ad alto rischio perché rende possibile l'immediato adeguamento della pressione che aumenta considerevolmente nella zona sacrale quando il paziente passa dalla posizione supina alla posizione seduta.

Il materasso presentato dalla ditta MEDIFM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) non risulta essere dotato di un sensore per la rilevazione specifica della pressione a livello lombosacrale in grado di rilevare il cambiamento pressorio dovuto alla variazione della postura che consente un adeguamento nell'immediato della pressione di gonfiaggio delle celle sottoposte alla maggior pressione.

Tale materasso risulta invece essere dotato di un sensore a gestione pneumatica, collocato a livello della centralina elettronica del motore (come risulta dalla brochure agli atti) che è in grado di controllare e gestire le variazioni di pressione su tutta la superficie del materasso con un dato medio ridistribuendo soltanto la quantità d'aria presente all'interno delle celle del materasso senza privilegiare le celle nella zona dove è maggiore la pressione.

Alla luce di tali motivazioni si conferma il giudizio espresso dalla precedente Commissione Giudicatrice e pertanto il modello AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR non risulta idoneo rispetto alla caratteristica essenziale richiesta a pena di esclusione al punto A-14 della scheda tecnica All.to 1).

#### Caratteristiche e prestazioni tecniche qualitative oggetto di valutazione.

Di seguito si espongono i giudizi della Commissione che vengono assegnati secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara".

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*  
50



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

LOTTO 1		
Sotto lotto B	Modalità di attribuzione	Punti 25
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e nel tempo in cui viene mantenuta parte statica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13

**Ditta HILL ROM:** il sistema presentato mod. CLINE ACTIVE garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo, ed è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.

**Ditta KCI:** il sistema presentato mod. PROFICARE garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC per il 60% del ciclo. Parte statica: 6 cm; parte dinamica: 14 cm.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: OTTIMO;**

**KCI: BUONO;**

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
-----	---	--	---

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di consegna e ritiro dei sistemi (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

**Ditta HILL ROM** ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con problemi respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione, gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

**Ditta KCI** ha proposto come migliorie ritenute più significative:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 op. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Merooni, 23 13000 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare. Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

HILL-ROM: OTTIMO;

KCI: OTTIMO;

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Ditta HILL ROM: il sistema proposto è dotato di portata terapeutica di 160Kg;

Ditta KCI: il sistema proposto è dotato di una portata terapeutica di 185 Kg.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

HILL- ROM: BUONO;

KCI: OTTIMO;

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

**REGIONE  
PIEMONTE**


www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Gamma dei materassi:

Ditta HILL ROM: dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x203);

Ditta KCI: dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 e da 90);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

Per le motivazioni sopra riportate il parametro in esame è considerato soddisfatto in tutte le sue voci per tutte due le ditte:

Dopo aver assegnato i giudizi la Commissione termina i lavori alle ore 15,30, da atto che la seduta è stata sospesa per la pausa del pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00 e si aggiorna al 21/03/2011.

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

Dott.ssa Maria Raiteri. *Maria Raiteri*

Sig. Massimo Poletti *Massimo Poletti*

Sig.ra Veronica Scianguetta *Veronica Scianguetta*

Sig.ra Roberta Pesce *Roberta Pesce*

Sig.ra Anna Riso *Anna Riso*

Rag. Elena Maestrelli segretaria verbalizzante *Elena Maestrelli*

\*\*\*\*\*



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 – 13900 Biella  
Tel. 015-33031 Fax. 015-330343  
www.aslbi.piemonte.it

**S.O.C. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI**

Direttore: Dott.ssa Maria Raiteri  
Ospedale degli Infermi  
Via Caraccio, 5/a – 13900 Biella  
Tel. 015-3503593-449  
elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI  
ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. dell'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE  
"NO" per la durata di 36 mesi.**

Il giorno 13 dicembre 2010 alle ore 10,30, presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio, 5, ha luogo la seduta della Commissione giudicatrice, competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura Aperta in oggetto.

La Commissione giudicatrice, individuata con deliberazione del Direttore Generale n° 280 del 29.04.2010 e successiva n° 461 del 14.07.2010, risulta così composta:

- Dott.ssa Maria Raiteri - Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni – Presidente;
- Sig. Massimo Poletti – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Veronica Scianguetta – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Roberta Pesce – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Claudia Gatta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni: Segretaria verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice è presente al completo.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice informa i componenti che è pervenuta in data 09.12.2010, da parte della ditta MEDI FM SERVICE, "Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale" ai sensi dell'art. 243 bis del D. lgs 163/2006 avverso il giudizio di non idoneità dell'offerta presentata per il lotto 1 sottolotto B), espresso dalla Commissione medesima nella seduta del 30.11.2010.

Il Presidente procede a dare lettura integrale della nota della ditta medesima del 07.12.2010.

La Commissione Giudicatrice, sulla base dell'informativa ricevuta, decide all'unanimità di riaprire l'esame valutativo e di rinviare l'approfondimento degli aspetti tecnici sollevati dalla ditta MEDI FM SERVICE a successive sedute.


Seguiranno comunicazioni informali tra il segretario e i componenti della Commissione per verificare la disponibilità e fissare la data della prossima seduta.

La seduta si chiude alle ore 13,00.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Raiteri. 

Sig.ra Elena Maestrelli segretaria verbalizzante. 



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-350345  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**S.O.C. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI**

Direttore: Dott.ssa Maria Raiteri

Ospedale degli Infermi

Via Caraccio, 5/a - 13900 Biella

Tel. 015-3503593-449

elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI  
SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. dell'AREA DI  
COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" per la durata di 36 mesi.**

**VERBALE N° 2**

**Commissione giudicatrice**

In data 30 novembre 2010 alle ore 11,30 presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio n° 5, - ha inizio la seduta conclusiva della Commissione Giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura Aperta in oggetto.

La Commissione giudicatrice presente al completo, individuata con deliberazione del Direttore Generale n° 280 del 29.04.2010 e successiva n° 461 del 14.07.2010, risulta così composta:

- Dott.ssa Maria Raiteri- Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni - Presidente;

**COMPONENTI:**

- Sig. Massimo Poletti - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Veronica Scianguetta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Roberta Pesce - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Claudia Gatta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni: Segretaria verbalizzante.

La Commissione prende atto che nella precedente seduta del 25/08/2010 l'esame istruttorio della documentazione presentata dalla ditte nonché la prova/visione al è stato affidato componenti Massimo Poletti, Veronica Scianguetta, Anna Riso, Roberta Pesce, Claudia Gatta con la facoltà di richiedere il supporto tecnico dell'Ing. Clinico Alberto Petti, Direttore della S.O.S. di Ingegneria Clinica ed il compito di redigere, al termine del predetto esami istruttorio, apposita relazione finale.

In data odierna la sottocommissione relaziona in merito alle prove visioni effettuate e alla lettura della documentazione tecnica.

Sono state visionate le seguenti apparecchiature:

Ditta	LOTTO 1 mod. offerti	LOTTO 2 mod. offerto
HILL ROM	Sotto lotto A: mod. PRIMO	CLINEACTIVE MCM
	Sotto lotto B: mod. CLINEACTIVE	
KCI MEDICAL	Sotto lotto A: Airwork Sure	THERAKAIR VISION
	Sotto lotto B: Proficare	
MEDI FM SERVICE	Sotto lotto A: AIR CONCEPT HC04	AUTO AIR SELECT
	Sotto lotto B: AIR EXPRESS	



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



RA M H CG M

2021 55

**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**SEDE LEGALE**Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**LOTTO 1****SOTTO LOTTO A**

	<b>LOTTO 1 Sotto lotto A</b>	<b>Modalità di attribuzione</b>	<b>Punti 25</b>
<b>B-1</b>	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale e nel tempo in cui viene mantenuta l'altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	<b>13</b>

Il sistema presentato dalla ditta Hill - Rom (mod. Primo) presenta un sensore sotto il bacino che rileva costantemente la pressione di gonfiaggio garantendo la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo.

Parte statica: cm 3 cm; parte dinamica 13cm.

Il sistema presentato dalla ditta KCI (mod. Air Work Sure) dispone anch'esso di un rilevatore posizionato sotto il bacino garantendo una miglior gestione dello scarico dei pesi in posizione seduta per il 60% del ciclo.

Parte statica: 7 cm.; parte dinamica: 14 cm.;

Il sistema presentato dalla ditta MEDI FM (Auto Air Select) risponde alle caratteristiche minime essenziali richieste (50%/ciclo).

Parte statica: 5cm.; parte dinamica: 13 cm.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: OTTIMO;**

**KCI: BUONO;**

**MEDI-FM: SUFFICIENTE;**

<b>B-2</b>	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	<b>7</b>
------------	---	--	----------

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



RA A [signature] 29 [signature] 56  
Rel





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° stadio per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta **HILL ROM** ha proposto come miglioria:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilizzazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilizzazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- un sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

La ditta **MEDI FM** non ha proposto migliorie.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare. Le ditte **HILL ROM** e **KCI**, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta **MEDI FM** ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM:** OTTIMO;  
**KCI:** OTTIMO;  
**MEDI-FM:** SUFFICIENTE;

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Tutti i sistemi presentati dispongono di una portata terapeutica sovrapponibile.

Tutti i sistemi presentati dispongono di una portata terapeutica sovrapponibile:

**HILL ROM:** 150 Kg.

**KCI:** 153 Kg.

**MEDI FM:** 150 Kg.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:





**HILL-ROM:** BUONO;  
**KCI:** BUONO;  
**MEDI-FM:** BUONO;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/ssa/im

 **Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

RA 7     57



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella

Tel. 015 35031 Fax. 015 350315

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01610260024

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

HILL Rom dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x200);

KCI dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 a da 90);

MEDI FM dispone di un sola misura di materassi (cm. 87x205);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

KCI: 2;

HILL-ROM: 2;

MEDI-FM: 2;

### SOTTO LOTTO B

Relativamente a questo Sotto Lotto B, il modello presentato dalla ditta MEDIFM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso. Tale caratteristica non risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara, ed in particolare dalla caratteristica espressa al punto A-14 (Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale) che richiede la possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale).

A tal fine di acquisisce il parere del Responsabile della S.O.S. Ingegneria Clinica che si allega alla presente relazione.

Per tale motivazione il modello non risulta idoneo rispetto alle caratteristiche essenziali richieste a pena di esclusione.

Pertanto non si procederà nella valutazione di tale modello.

LOTTO 1 Sotto lotto B	Modalità di attribuzione	Punti 25
--------------------------	--------------------------	----------

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



RA 1

58

**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**SEDE LEGALE**Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13
-----	--	--	----

Il sistema presentato dalla ditta Hill - Rom (mod. Cline Active) garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo, ed è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.

Il sistema presentato dalla ditta KCI (mod. Proficare) garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC per il 60% del ciclo. Parte statica: 8 cm; parte dinamica: 14 cm.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: OTTIMO;**

**KCI: BUONO;**

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
-----	---	--	---

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art. 10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art. 12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta HILL ROM ha proposto come miglioria:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

La ditta MEDI FM non ha proposto migliorie.

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

RA 1

*[Handwritten signatures and initials]*

58



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015 35031 Fax. 015 3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare. Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: OTTIMO;**

**KCI: OTTIMO;**

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Il sistema proposto dalla ditta HILL ROM (Cline Active) è dotato di portata terapeutica di 160Kg mentre il sistema proposto dalla ditta KCI (Proficare) di una portata terapeutica di 185 Kg.

Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**HILL-ROM: BUONO;**

**KCI: OTTIMO;**

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

Hill Rom dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x203);

KCI dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 e da 90);

MEDI FM dispone di un sola misura di materassi (cm. 86x203);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.


Per le motivazioni sopra esposte si esprimono i seguenti giudizi:

**KCI: 2;**

**HILL-ROM: 2;**

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura  
senza cuore**  
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*RAI*  
*[Handwritten signatures and initials]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015 35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

## LOTTO 2

	LOTTO 2	Punti 50	Criterio motivazionale
B-1	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie	14	Verrà valutato il maggior indice MVTR e la maggiore superficie di distribuzione dell'aria assegnando il punteggio con l'attribuzione dei seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
B-2	Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	12	Verrà valutata l'efficacia del presidio, in termini di prevenzione della macerazione cutanea (Allegato 4) in soggetti con lesioni, o gestione del paziente ad alto rischio attraverso la tecnologia utilizzata e studi clinici da presentare in lingua italiana attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.

Il materasso presentato dalla ditta KCI presenta un indice MVTR pari a 10.000/gr/m<sup>2</sup>/24h; quello presentato da MEDI-FM un indice MVTR di 557/gr/m<sup>2</sup>/24h e HILL-ROM un MVTR di 450/gr/m<sup>2</sup>/24h.

I materassi presentati dalle ditte MEDI FM- SERVICE e KCI MEDICAL rientrano nella tipologia analizzata dalla "Revisione" della Cochrane che definisce come valido, nella gestione delle lesioni cutanee, l'utilizzo dei materassi a cessione d'aria.

Nel sistema presentato dalla ditta KCI la maggior distribuzione dell'aria è garantita dalla traspirazione dell'aria su tutta la superficie del materasso e dal materiale di cui il telo di copertura è costituito. E' inoltre da rilevare che il prodotto Therakair dispone della modalità denominata pulsoterapia che migliora la gestione del paziente ad alto rischio (come da studio presentato).

Nel materasso presentato dalla ditta MEDI FM- SERVICE la superficie di distribuzione dell'aria non risulta omogenea su tutta la superficie del materasso ma è collegata ai fori di fuoriuscita posizionati agli estremi laterali di ogni cella ed il telo di copertura, non chiudendo completamente il materasso, provoca una maggiore dispersione (anche verso il basso) dell'aria.

Per quanto riguarda il prodotto presentato dalla ditta HILL ROM, lo stesso viene definito dalla ditta come "sistema a microcessione d'aria"; si reputa che la tecnologia utilizzata per tale sistema, spiegata nella fase dimostrativa, sia adeguata per gestire la prevenzione della macerazione cutanea pur in assenza di studi clinici.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

KCI: OTTIMO;  
HILL-ROM: SUFFICIENTE;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
-----	---	----	--

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura  
senza cuore

Regione Sanitaria Regionale del Piemonte



RA 11 09 19 2001



# A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta HILL ROM ha proposto come miglioria:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilizzazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilizzazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

La ditta MEDI FM non ha proposto migliorie.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare.

Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

KCI: OTTIMO;  
HILL-ROM: OTTIMO;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	Verrà valutata congiuntamente l'altezza della parte dinamica, l'altezza della parte statica attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
-----	--------------------------------------	---	---

Il sistema proposto dalla ditta HILL ROM è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.


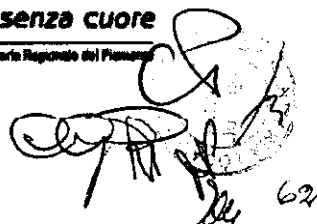
La ditta MEDI-FM presenta un sistema dotato di una parte statica di 4 cm e parte dinamica di 20 cm.

La ditta KCI presenta un sistema dotato da una parte statica di 8 cm ed una parte dinamica di 16 cm.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

KCI: OTTIMO;  
HILL-ROM: SUFFICIENTE;  
MEDI-FM: SUFFICIENTE;

RAN

**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**SEDE LEGALE**Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.
-----	--	---	---

Durante la prova visione sono state presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

Tutte le ditte hanno dichiarato la disponibilità dei materassi (come da richiesta specifica dei requisiti essenziali).

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

Per le motivazioni sopra riportate si producono i seguenti giudizi:

KCI: 5;

HILL-ROM: 5;

MEDI-FM: 5;

Dopo aver assegnato i giudizi la Commissione passa ad attribuire i punteggi relativi che di seguito si elencano.

#### PUNTEGGIO FINALE

**Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio-**  
**Sottolotto A**

		Punti 25	HILL ROM (Primo)	KCI (Air WorkSure)	MEDI FM SERVICE (Auto Air Select)
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	13	13	10,4	6,5
B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	7	7	7	3,5
B-3	Portata terapeutica	3	2,4	2,4	2,4

  
63



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	2	2	2	2
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>24,4</b>	<b>21,8</b>	<b>14,4</b>

**Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio-**  
**Sottolotto B**

		Punti 25	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)	MEDI FM SERVICE (Air Concept HC04)
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	13	13	10,4	esclusa
B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	7	7	7	
B-3	Portata terapeutica	3	2,4	3	
B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	2	2	2	
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>24,4</b>	<b>22,4</b>	

**TOTALE LOTTO 1**

	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)	MEDI FM SERVICE (Air Concept HC04)
SOTTO LOTTO A	24,4	21,8	14,4
SOTTO LOTTO B	24,4	22,4	esclusa
<b>TOTALE LOTTO 1</b>	<b>48,8</b>	<b>44,2</b>	<b>Non attribuito</b>

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Regione Sanitaria Regionale del Piemonte

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.asibi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**Lotto 2: Materassi a Cessione d'aria (gestione microclima e macerazione)**

		Punti 50	HILL ROM (Cline Active + MCM)	KCI (THERAKAIR VISION)	MEDI FM SERVICE (Air Express)
B-1 e B-2	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie e Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	14 + 12	13	26	13
B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	11	11	5,5
B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	4	8	4
B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	5	5	6
	<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>50</b>	<b>27,5</b>

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla normalizzazione dei punteggi:

**Lotto 1**

	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)
<b>TOTALE LOTTO 1</b>	<b>48,8</b>	<b>44,2</b>
<b>PUNTEGGIO NORMALIZZATO</b>	<b>50</b>	<b>45,286</b>

Per il Lotto 2 avendo la ditta KCI ottenuto 50 punti su 50 non è necessario procedere a tale operazione in quanto i punteggi sono già normalizzati a 50.

La seduta si chiude alle ore 16,00

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

Dott.ssa Maria Ralteri ..... *Maria Ralteri*Sig. Massimo Poletti ..... *Massimo Poletti*Sig.ra Veronica Scianguetta ..... *Veronica Scianguetta*Sig.ra Roberta Pesce ..... *Roberta Pesce*Sig.ra Anna Riso ..... *Anna Riso*Sig.ra Claudia Gatta ..... *Claudia Gatta*Reg. Elena Maestrelli segretaria verbalizzante ..... *Elena Maestrelli*

\*\*\*\*\*

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*CA*  
65

# **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE aa.ss.ii. dell'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO"**

## **Relazione tecnica Sotto-commissione**

La Commissione Giudicatrice in data 25.08.2010 ha affidato l'esame istruttorio della documentazione presentata dalla ditte nonché la prova/visione ai componenti Massimo Poletti, Veronica Scianguetta, Anna Riso, Roberta Pesce, Claudia Gatta, i quali potranno chiedere un supporto tecnico all'Ingegnere Clinico Ing. Alberto Petti Responsabile della S.O.S. Ingegneria Clinica, con il compito di redigere, al termine del predetto esame istruttorio, apposita relazione finale.

A tal fine i predetti componenti si sono riuniti, presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio n° 5, nelle date del 17/09, 04/10, 3/11 (giorno della prova/visione) 12/11, 16/11 e 30/11.

Si precisa che durante l'esame della documentazione è stata evidenziata la necessità di chiarimenti ed informazioni integrative sui contenuti tecnici a carico delle tre ditte partecipanti di seguito evidenziate a cui la Segretaria della Commissione ha proceduto in data 01.10.2010 richiedendo alle singole ditte le seguenti precisazioni:

### Ditta Hill-Rom



1. al fine di poter consentire un esame approfondito del contenuto delle schede tecniche (All.ti 1 e 2) si richiede di fornire, per ogni caratteristica "essenziale" (punti A-XX) e soggetta a "valutazione" (punti B-XX), i riferimenti (n°/nome documento, n° pagina, n° paragrafo, n° capitolo, etc.) dei documenti presentati atti ad individuare in modo più puntuale le caratteristiche e le prestazioni proposte in gara.
2. relativamente alla sanificazione del sistema: si chiede di precisare se la sanificazione contempla la sola cover oppure anche il materasso e in tal caso con quali modalità;
3. relativamente alle modalità di consegna e ritiro: si chiede di precisare se la procedura indicata nella sezione "Rimozione prodotti" a pag. 2 di 41 dell'Allegato 5 sia da eseguire da parte dell'operatore sanitario o da parte dell'operatore della ditta fornitrice;


### Ditta KCI Medical

1. al fine di poter consentire un esame approfondito del contenuto delle schede tecniche (All.ti 1 e 2) si richiede di fornire, per ogni caratteristica "essenziale" (punti A-XX) e soggetta a "valutazione" (punti B-XX), i riferimenti (n°/nome documento, n° pagina, n° paragrafo, n° capitolo, etc.) dei documenti presentati atti ad individuare in modo più puntuale le caratteristiche e le prestazioni proposte in gara.
2. relativamente alla caratteristica valutata al punto B-1 (dell' All.to 1) "Pressione di contatto su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica": è stata dichiarata l'altezza della parte statica; si chiede di integrare con l'altezza della parte dinamica;
3. relativamente alla caratteristica valutata al punto B-3 "portata terapeutica": è stata dichiarata la portata terapeutica minima (come richiesto dalla scheda tecnica punto A-11 dell'Allegato 1); si chiede di integrare con la portata terapeutica massima certificata;
4. relativamente alla caratteristica valutata al punto B-4 in particolare al parametro "Massima gamma di materassi": si chiede di integrare circa la disponibilità della gamma;

### Ditta MEDI FM

1. Relativamente alla caratteristica A-4 prevista nella sezione "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" dell'Allegato 1) Sotto lotto A: "Disponibilità gamma di materassi compatibili con letti di larghezza da 80 a 90 cm. e lunghezza da 190 a 200 cm in condizioni di gonfiaggio standard" codesta ditta ha dichiarato tale disponibilità mentre da un esame della scheda tecnica presentata a corredo della documentazione tecnica richiesta risulta alla voce "Dimensioni materasso: cm.205x87x18. Si richiede a tal proposito di fornire precisazioni.
2. Inoltre al fine di poter consentire un esame approfondito del contenuto delle schede tecniche (All.ti 1 e 2) si richiede di fornire, per ogni caratteristica "essenziale" (punti A-XX) e soggetta a "valutazione" (punti B-XX), i riferimenti (n°/nome documento, n° pagina, n° paragrafo, n° capitolo, etc.) dei documenti presentati atti ad individuare in modo più puntuale le caratteristiche e le prestazioni proposte in gara.

RA  

  
66

In data odierna la sottocommissione a conclusione dei lavori di istruttoria e in seguito alla prova visione effettuate (il 03.11.2010) redige la presente relazione.

Sono state visionate le seguenti apparecchiature:

Ditta	LOTTO 1 mod. offerti	LOTTO 2 mod. offerto
HILL ROM	Sotto lotto A: mod. PRIMO	CLINEACTIVE MCM
	Sotto lotto B: mod. CLINEACTIVE	
KCI MEDICAL	Sotto lotto A: Airwork Sure	THERAKAIR VISION
	Sotto lotto B: Proficare	
MEDI FM SERVICE	Sotto lotto A: AIR CONCEPT HC04	AUTO AIR SELECT
	Sotto lotto B: AIR EXPRESS	

	LOTTO 1 Sotto lotto A	Modalità di attribuzione	Punti 25
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta l'altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13

Il sistema presentato dalla ditta Hill - Rom (mod. Primo) presenta un sensore sotto il bacino che rileva costantemente la pressione di gonfiaggio garantendo la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo.  
Parte statica: cm 3 cm; parte dinamica 13cm.

Il sistema presentato dalla ditta KCI (mod. Air Work Sure) dispone anch'esso di un rilevatore posizionato sotto il bacino garantendo una miglior gestione dello scarico dei pesi in posizione seduta per il 60% del ciclo.

Parte statica: 7 cm.; parte dinamica: 14 cm.;

Il sistema presentato dalla ditta MEDI FM (Auto Air Select) risponde alle caratteristiche minime essenziali richieste (50%/ciclo).

Parte statica: 5cm.; parte dinamica: 13 cm.

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
-----	---	--	---

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° stadio per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta HILL ROM ha proposto come miglioria:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.

- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
  - un sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
  - Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.
- La ditta **MEDI FM** non ha proposto migliorie.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte tre le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare. Le ditte **HILL ROM** e **KCI**, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica. La ditta **MEDI FM** ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Tutti i sistemi presentati dispongono di una portata terapeutica sovrapponibile:

**HILL ROM:** 150 Kg.

**KCI:** 153 Kg.

**MEDI FM:** 150 Kg.

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro. Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

**Hill Rom** dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x200);

**KCI** dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 e da 90);

**MEDI FM** dispone di un sola misura di materassi (cm. 87x205);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

## LOTTO 1 - SOTTO LOTTO B

Relativamente a questo Sottolotto B, il modello presentato dalla ditta MEDIFM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso. Tale caratteristica non risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara, ed in particolare dalla caratteristica espressa al punto A-14 (Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale) che richiede la possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale). A tal fine di acquisire il parere del Responsabile della S.O.S. Ingegneria Clinica che si allega alla presente relazione. Per tale motivazione il modello non risulta idoneo rispetto alle caratteristiche essenziali richieste a pena di esclusione. Pertanto non si procederà nella valutazione di tale modello.

LOTTO 1 Sotto lotto B			Punti 25
	Modalità di attribuzione		
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta l'altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima altezza della parte dinamica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13

Il sistema presentato dalla ditta Hill - Rom (mod. Cline Active) garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC costantemente e quindi per il 100% del ciclo, ed è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.

Il sistema presentato dalla ditta KCI (mod. Proficare) garantisce la minima pressione di contatto al di sotto della POC per il 60% del ciclo. Parte statica: 6 cm; parte dinamica: 14 cm.

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
-----	---	--	---

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di sanificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art.10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art.12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta HILL ROM ha proposto come miglioria:


- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.

RA

RA

RA

RA



- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
  - Il Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.
- La ditta MEDI FM non ha proposto migliore.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare. Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica. La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
-----	---------------------	---	---

Il sistema proposto dalla ditta HILL ROM (Cline Active) è dotato di portata terapeutica di 160Kg mentre il sistema proposto dalla ditta KCI (Proficare) di una portata terapeutica di 185 Kg.

B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2
-----	--	--	---

Durante la prova visione sono stati presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

HILL Rom dispone di un sola misura di materassi (cm. 85x203);

KCI dispone di due misure di larghezza (cm. da 80 e da 90);

MEDI FM dispone di un sola misura di materassi (cm. 86x203);

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

LOTTO 2		Punti 50	Criterio motivazionale
B-1	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie	14	Verrà valutato il maggior indice MVTR e la maggiore superficie di distribuzione dell'aria assegnando il punteggio con l'attribuzione dei seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
B-2	Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	12	Verrà valutata l'efficacia del presidio, in termini di prevenzione della macerazione cutanea (Allegato 4) in soggetti con lesioni, o gestione del paziente ad alto rischio attraverso la tecnologia utilizzata e studi clinici da presentare in lingua italiana attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.

Il materasso presentato dalla ditta KCI presenta un indice MVTR pari a 10.000/gr/m<sup>2</sup>/24h; quello presentato da MEDI-FM un indice MVTR di 557/gr/m<sup>2</sup>/24h e HILL-ROM un MVTR di 450/gr/m<sup>2</sup>/24h.

I materassi presentati dalle ditte MEDI FM- SERVICE e KCI MEDICAL rientrano nella tipologia analizzata dalla "Revisione" della Cochrane che definisce come valido, nella gestione delle lesioni cutanee, l'utilizzo dei materassi a cessione d'aria.

Nel sistema presentato dalla ditta KCI la maggior distribuzione dell'aria è garantita dalla traspirazione dell'aria su tutta la superficie del materasso e dal materiale di cui il telo di copertura è costituito. E' inoltre da rilevare che il prodotto Therakair dispone della modalità denominata pulsoterapia che migliora la gestione del paziente ad alto rischio (come da studio presentato).

Nel materasso presentato dalla ditta MEDI FM- SERVICE la superficie di distribuzione dell'aria non risulta omogenea su tutta la superficie del materasso ma è collegata ai fori di fuoriuscita posizionati agli estremi laterali di ogni cella ed il telo di copertura, non chiudendo completamente il materasso, provoca una maggiore dispersione (anche verso il basso) dell'aria.

RA [signature]

[signature] [stamp]

Per quanto riguarda il prodotto presentato dalla ditta HILL ROM, lo stesso viene definito dalla ditta come "sistema a microcessione d'aria"; si reputa che la tecnologia utilizzata per tale sistema, spiegata nella fase dimostrativa, sia adeguata per gestire la prevenzione della macerazione cutanea pur in assenza di studi clinici.

B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
-----	---	----	--

Questo parametro prende in considerazione il progetto tecnico sotto il profilo del sistema di santificazione (art. 8), servizio noleggio assistenza tecnica (art. 9), dotazione di stand by (art. 10), modalità di sistema e ritiro (art. 11) e informatizzazione del servizio (art. 12) oltre ad eventuali aspetti migliorativi.

Tutte le ditte hanno proposto un servizio conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale agli art. 8,9,10,11.

La ditta KCI ha proposto come miglioria:

- un servizio di "ritiro/consegna e manutenzione" (art. 11) 7gg. su 7;
- due incontri formativi ECM di 8 ore l'anno;
- letto terapeutico fluidizzato per pazienti ospedalieri ad alto rischio ad uso gratuito per 30 gg.
- letto terapeutico per pazienti ospedalieri con complicanze polmonari per 10 gg. per ogni azienda ospedaliera;
- cuscino antidecubito, per pazienti ospedalieri, in omaggio per numero 25 pz/anno per i primi due anni;
- sistema antidecubito per barella, per pazienti ospedalieri, n° 2 pz. per azienda;
- indagini di prevalenza per pazienti ospedalieri: n° 2 rilevazioni all'anno per Azienda Ospedaliera senza onere aggiuntivo;
- un cuscino antidecubito per la zona sacrale o ischiatica o per posture sedute prolungate per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- un cuscino antidecubito gratuito in caso di lesioni dal 2° al 4° grado per le zone occipitali, talloni, gomiti, zigomi e orecchie per ogni paziente territoriale cui viene consegnato un sistema antidecubito;
- Indagini di prevalenza per pazienti domiciliari senza onere aggiuntivo;

La ditta HILL ROM ha proposto come miglioria:

- servizio di terapia continuativa con cuscino antidecubito ad aria in uso gratuito per tutta la durata della fornitura in un quantitativo massimo di 30 unità;
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti respiratori e particolarmente critici o con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 150.
- Sistema terapeutico per pazienti obesi gratuito nei primi 36 mesi per 150 giornate.
- sistemi terapeutici completi per il trattamento di pazienti con particolari necessità di mobilitazione gratuitamente per numero di giornate 200.
- Un Sistema per trasferimento pazienti in utilizzo gratuito per tutta la durata della fornitura;
- Un Sistema sollevamento pazienti portata di max 250Kg per tutta la durata della fornitura.

La ditta MEDI FM non ha proposto migliorie.

Relativamente a quanto previsto all'art. 12 tutte le ditte hanno portato in visione il software così come previsto dal disciplinare.

Le ditte HILL ROM e KCI, hanno effettuato una presentazione operativa del software così come richiesto espressamente in capitolato. Ciò ha reso possibile una visione reale delle funzionalità di detto software relative alle fasi di richiesta di materassi, trasferimento presso altri reparti, richiesta di sostituzione e manutenzione e reportistica.

La ditta MEDI FM ha presentato un software privo di un reale collegamento internet non rendendo possibile una presentazione operativa del software.


B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	Verrà valutata congiuntamente l'altezza della parte dinamica, l'altezza della parte statica attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
-----	--------------------------------------	---	---

Il sistema proposto dalla ditta HILL ROM è costituito da una superficie antidecubito multistrato e multizona integralmente ad aria con una altezza complessiva del sistema terapeutico di 18 cm.

La ditta MEDI-FM presenta un sistema dotato di una parte statica di 4 cm e parte dinamica di 20 cm.

La ditta KCI presenta un sistema dotato da una parte statica di 8 cm ed una parte dinamica di 16 cm.

B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura
-----	--	---	---



			maggior parte delle tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.
--	--	--	--

Durante la prova visione sono state presi in esame tutti gli elementi oggetto del parametro.

Tutte le ditte hanno presentato caratteristiche nel complesso equivalenti.

Allarmi: tutti i sistemi presentati sono dotati di allarmi visivi posizionati in modo tale da consentire una agevole gestione degli stessi e allarmi acustici tutti udibili al di fuori della stanza in condizioni ordinarie di rumorosità;

Gamma dei materassi:

Tutte le ditte hanno dichiarato la disponibilità dei materassi (come da richiesta specifica dei requisiti essenziali).

Sistema aggancio al letto: tutti i sistemi presentati presentano sistemi sovrapponibili.

I componenti della Sotto-Commissione:

Sig. Massimo Poletti ..... *Massimo Poletti* .....  
 Sig.ra Veronica Sciangatta ..... *Veronica Sciangatta* .....  
 Sig.ra Roberta Pesce ..... *Roberta Pesce* .....  
 Sig.ra Anna Riso ..... *Anna Riso* .....  
 Sig.ra Claudia Gatta ..... *Claudia Gatta* .....





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE  
Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**S.O.S. INGEGNERIA CLINICA**  
Direttore: Dr. Ing. Alberto Petti  
Ospedale degli Infermi  
Via Caraccio, 5/a - 13900 Biella  
Tel. 015-3503000 Fax. 015-3503000  
alberto.petti@aslbi.piemonte.it

PROVVEDITORATO ECONOMATO

29 NOV. 2010

ARRIVO

Biella, 29/11/2010

Prot. n. 114/2010

**S.C. Approvvigionamento Beni**  
c.a. Dr.ssa Maria Raiteri  
e.p.c. Sig.ra Elena Maestrelli

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL dell'area di coordinamento sovrazonale "NO" per la durata di 36 mesi.**

Come richiesto si rende il parere di competenza.

In merito alla possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta mantenendo le condizioni di opportuno scarico pressorio (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale) si sottolinea che il modello presentato dalla ditta MEDIFM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR), per la gara in oggetto, non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso.

Per quanto riguarda la conformità normativa dal punto di vista certificativi si evidenzia che tutti i prodotti presentati sono conformi ai dettami della normativa vigente.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

**Responsabile S.O.S. Ingegneria Clinica**

Ing. Alberto Petti

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura  
senza cuore

Il Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



# A.S.L. BI

**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**

**SEDE LEGALE**

**Via Marconi, 23 – 13900 Biella**

**Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545**

[www.as/bi.piemonte.it](http://www.as/bi.piemonte.it)

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**S.O.C. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI**

**Direttore: Dott.ssa Maria Raiteri**

**Ospedale degli Infermi**

**Via Caraccio, 5/a - 13900 Biella**

Tel. 015-3503593-449

[elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it](mailto:elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. dell’AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE “NO” per la durata di 36 mesi.**

## VERBALE N° 1

### **Commissione giudicatrice**

In data 25 agosto 2010 alle ore 9,30 presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio, 5 ha inizio la prima seduta della Commissione giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura Aperta in oggetto.

La Commissione giudicatrice, individuata con deliberazione del Direttore Generale n° 280 del 29.04.2010 e successiva n° 461 del 14.07.2010, risulta così composta:

- **Dott.ssa Maria Raiteri- Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni – Presidente:**

**COMPONENTI:**

- Sig. Massimo Poletti – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Veronica Scianguetta – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Roberta Pesce – Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Sig.ra Claudia Gatta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Componente;
- Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni: Segretaria verbalizzante.

**In data odierna la Commissione, presente al completo, prende atto:**

1. del Verbale di apertura dei plichi principali, esame della documentazione contenuta nelle buste "Documentazione amministrativa" e verifica di regolarità formale del contenuto della busta "Offerta Tecnica", redatto dall'Ufficiale Rogante n° 2150 in data 30.04.2010, da cui risulta quanto segue:
- entro il termine perentorio, stabilito nel Bando di Gara (ore 16 del giorno 16.04.2010 poi prorogato al 26.04.2010), sono pervenuti i plichi inviati dalle ditte:
    - 1. HILL ROM S.p.a. – Rodano;
    - 2. KCI MEDICAL S.r.l. – Assago;
    - 3. MEDI FM SERVICE S.r.l. – Volpiano.
  - la ditta HILL ROM S.p.a. – Rodano: è stata ammessa al prosieguo della gara avendo presentato la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Disciplinare di gara;

**REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/asp/imp](http://www.regione.piemonte.it/asp/imp)



**Non c'è cura  
senza cuore**

### Sistema Estructura Base para el Planon

RA OG A

[Handwritten signature]

[Circular stamp]



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- > la ditta KCI MEDICAL S.r.l. - Assago: è stata ammessa al prosieguo della gara avendo presentato la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Disciplinare di gara;
- > la ditta MEDI FM SERVICE S.r.l. - Volpiano: è stata ammessa al prosieguo della gara per il lotto 1, avendo presentato la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Disciplinare di gara, mentre è stata ammessa con riserva di verifica sulla possibilità di avvalimento per il lotto 2, avendo presentato un avvalimento parziale;
2. che il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'ex art. 48 del Decreto Legislativo n° 163/06, a carico della ditta KCI MEDICAL di Assago ha dato esito positivo;
3. che con verbale del 12.05.2010, la riserva a carico della ditta MEDI FM SERVICE per il lotto 2, è stata sciolta in quanto dalla documentazione agli atti si evince che l'avvalimento in questione è legittimo.

A questo punto la il Presidente della Commissione Giudicatrice, prima di procedere alla visione della documentazione tecnica presentata dalle ditte, dà lettura degli atti di gara, in particolare di quanto disposto nel Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara", ove è previsto che l'aggiudicazione avverrà, a lotti separati, a favore della Ditta che avrà formulato, per ciascun lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., individuata secondo i criteri qualità prezzo come di seguito dettagliati:

A)	QUALITA' :	punti	50/100
	Lotto 1:		25/100 (sottolotto A)
			25/100 (sottolotto B)
	Lotto 2:	punti	50/100
B)	PREZZO :	punti	50/100

e che, relativamente al lotto 1), lo stesso verrà aggiudicato in presenza di offerta congiunta per entrambi i sottolotti A e B.

Per l'assegnazione del punteggio relativo alla qualità dei sistemi si valuteranno, pertanto, le caratteristiche tecniche e di qualità suddivise nei seguenti due gruppi come dettagliato all'art. 6 del Capitolato Speciale:

- "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste" a pena di esclusione
- "Caratteristiche e prestazioni tecnico/qualitative oggetto di valutazione"

Per l'assegnazione dei 50 punti relativi alla qualità dei sistemi, la Commissione Giudicatrice valuterà le "Caratteristiche e prestazioni Tecnico/qualitative oggetto di valutazione" definite nelle Schede Tecniche (Allegato 1 e 2) ai punti B-XX e sotto richiamate, con la precisazione che relativamente al lotto 1 il punteggio di 50/100 sarà dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascun sotto lotto:

**Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio-**  
**Sottolotto A**

		Modalità di attribuzione	Punti 25
R-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e parte statica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	13

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'RR' and another that looks like '75'.

**A.S.L. BI**

**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**

**SEDE LEGALE**

**SEDE LEONARDO**  
**Via Marconi, 23 - 13900 Biella**

**Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545**

[www.es/bi.piemonte.it](http://www.es/bi.piemonte.it)

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	7
B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
B-4	<p>A. Allarmi</p> <p>B. Gamma di materassi</p> <p>C. Sistemi di aggancio al letto</p>	<p>A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente.</p> <p>B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende.</p> <p>C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante.</p> <p>Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.</p>	2

**Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio-  
Sottolotto B**

		<b>Modalità di attribuzione</b>	<b>Punti 25</b>
<b>B-1</b>	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	Verrà valutata la minima pressione di contatto per la massima percentuale/ciclo, la massima altezza della parte dinamica e parte statica e il rapporto fra di loro attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	<b>13</b>
<b>B-2</b>	Servizio sia ospedaliero che territoriale	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.	<b>7</b>

**REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



Non c'è cura  
senza cuore

**Sistema Sanitario Nazionale del Paraguay**

*[Handwritten signature]*

**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella

Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545

www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-3	Portata terapeutica	La valutazione verrà eseguita in funzione della massima portata terapeutica certificata attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.	3
B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.	2

**Lotto 2: Materassi e Cessione d'aria (gestione microclima e macerazione)**

		Punti 50	Criterio motivazionale
B-1	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie	14	Verrà valutato il maggior indice MVTR e la maggiore superficie di distribuzione dell'aria assegnando il punteggio con l'attribuzione dei seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
B-2	Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	12	Verrà valutata l'efficacia del presidio, in termini di prevenzione della macerazione cutanea (Allegato 4) in soggetti con lesioni, o gestione del paziente ad altro rischio attraverso la tecnologia utilizzata e studi clinici da presentare in lingua italiana attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.
B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	Verrà valutato il Progetto tecnico (Allegato 5), relativamente agli articoli 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale, oltre ad eventuali altri aspetti migliorativi rispetto alle attese attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	Verrà valutata congiuntamente l'altezza della parte dinamica, l'altezza della parte statica attribuendo i seguenti giudizi descrittivi: ottimo, buono, sufficiente.

**REGIONE  
PIEMONTE**


www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

RA 99

RA





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	A. Posizionamento degli allarmi visivi in grado di garantire una immediata visualizzazione degli stessi con conseguente agevole gestione. Allarmi acustici udibili al di fuori della stanza in ordinarie condizioni di rumorosità diurna dell'ambiente. B. Massima gamma di materassi a disposizione compatibili con i letti in dotazione presso le varie Aziende. C. Sistema di aggancio al letto pratico e poco ingombrante. Verrà dato il massimo punteggio alla ditta che avrà soddisfatto in misura maggiore tutte e tre le caratteristiche che saranno considerate, a carico di ciascuna ditta, in modo complementare e complessivo.
-----	--	---	---

I punteggi qualità verranno attribuiti secondo i seguenti valori di preferenza:

- Ottimo: pienamente corrispondente al criterio qualitativo a cui verrà attribuito un valore numerico pari al 100% del punteggio attribuibile;
- Buono: parzialmente corrispondente al criterio qualitativo a cui verrà attribuito un valore numerico pari all'80% del punteggio attribuibile;
- Sufficiente: appena corrispondente al criterio qualitativo a cui verrà attribuito un valore numerico pari al 50% del punteggio attribuibile;
- Insufficiente: scarsamente corrispondente al criterio qualitativo a cui verrà attribuito un valore numerico pari al 30% del punteggio attribuibile.

Il punteggio qualità finale (composto dai punteggi e sub-punteggi attribuiti secondo quanto specificato dai criteri motivazionali) sarà infine normalizzato a 50 punti secondo la seguente formula:

$Q_{fi} = 50 \cdot \frac{Q_i}{Q_M}$	$Q_{fi}$ è il punteggio finale assegnato all'i-esima ditta approssimato per difetto al terzo decimale $Q_i$ è il punteggio parziale non normalizzato dell'i-esima ditta $Q_M$ è il punteggio parziale massimo ottenuto dalle ditte a seguito della valutazione qualitativa
-------------------------------------	--

Formula 1: punteggio qualità

Inoltre, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara:

2. la Commissione Tecnica prima di procedere all'esclusione delle apparecchiature che risulteranno non avere anche una sola delle caratteristiche richieste nella sezione "Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste", potrà chiedere approfondimenti alla ditta in merito a quanto dichiarato negli Allegati 1 e 2.
3. le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione, dovranno essere dichiarate dalle Ditte concorrenti -ove previsto- nelle sezioni "Caratteristiche e prestazioni tecnico/qualitative oggetto di valutazione" delle schede tecniche sopra richiamate (Lotto 1: p.ti da B-1 a B-4; Lotto 2: p.ti da B-1 a B-5).

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura  
senza cuore**

Giudice Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and stamps]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

4. per la valutazione la Commissione Giudicatrice terrà conto della documentazione tecnica richiesta al punto B del presente Disciplinare di gara (studi clinici, progetto tecnico, etc.), delle risposte sintetiche prodotte sulle schede tecniche e di ogni altra documentazione prodotta ad integrazione di quella richiesta.
5. a tal fine la Commissione Giudicatrice potrà chiedere, qualora lo ritenga necessario, chiarimenti ed informazioni integrative sui contenuti tecnici.
6. l'ammissione alla fase finale della gara (apertura delle buste economiche ed aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) è vincolata:
  - alla presentazione in offerta di un modello per ciascun lotto e sottolotto.
  - al superamento, per ogni singolo lotto, da parte delle offerte candidate:
    - a) per il lotto 1, sotto lotto A, di una soglia minima di 13 punti, relativa al punteggio di qualità del sistema.
    - b) Per il lotto 1, sotto lotto B, di una soglia minima di 13 punti, relativa al punteggio di qualità del sistema.
    - c) Per il lotto 2, di una soglia minima di 26 punti relativa al punteggio di qualità del sistema.
7. le offerte che non raggiungeranno il punteggio qualitativo minimo (cioè totalizzeranno un punteggio inferiore a 13, per i singoli sottolotti A e B del Lotto 1, e 26 per il lotto 2 riferito ai punti B-XX della Scheda Tecnica) non saranno ammesse alla fase di aggiudicazione.

Terminata la lettura del disciplinare di gara la Commissione giudicatrice stabilisce all'unanimità:

1. di nominare una sottocommissione, per l'esame istruttorio della documentazione presentata dalla ditte e la valutazione della prova/visione, così composta: Massimo Poletti, Veronica Scianguetta, Anna Riso, Roberta Pesce, Claudia Gatta. Tale sottocommissione potrà richiedere, a supporto, il parere dell'Ing. Clinico Alberto Petti Direttore della S.O.S. di Ingegneria Clinica. Al termine dell'esame istruttorio predetto la suddetta sotto commissione redigerà relativa relazione conclusiva.
2. i dati tecnici indicati nelle schede tecniche, relativi ai requisiti "essenziali" e a quelli "oggetto di valutazione", verranno verificati/misurati in sede di prova dei presidi medesimi e in caso di discordanza verranno tenuti validi quelli ottenuti dalla prova visione;
3. la sessione di prova/visione dei sistemi offerti si svolgerà presso una camera di degenza messa a disposizione dalla Struttura Degenza in attività libero professionale/Dermatologia secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara ed avrà una durata di 1 ora e ¼ per ciascuna ditta offerente durante la quale dovranno essere visionati tutti modelli offerti e il sistema di gestione informatizzata del servizio proposto così come stabilito all'art. 12 del Capitolato Speciale.
4. relativamente al Lotto 2, viste le affinità tecniche, si decide di unificare i due parametri B-1 e B-2 in un unico criterio sommatoria dei due.

A questo punto la Commissione Giudicatrice prende atto della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti e stabilisce che la stessa verrà conservata e custodita in sicurezza presso gli uffici della S.O.C. Approvvigionamento di Beni.

La seduta si chiude alle ore 15,15 e si aggiorna a data da destinarsi.

Dott.ssa Maria Raiteri.....

Sig. Massimo Poletti.....

Sig.ra Veronica Scianguetta.....

Sig.ra Roberta Pesce.....

Sig.ra Anna Riso.....

Sig.ra Claudia Gatta.....

Rag. Elena Maestrelli segretaria verbalizzante.....

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Ministero Sanitario Regione del Piemonte

*[Handwritten signature and initials]*

FATO copia x dott. A. RAITERI  
09/12/10

EUENA

**MEDI FM SERVICE SRL**

VIA GIACOMO BATTISTINI N. 15, NOVARA  
C.F. P. IVA 01502740036

<b>A.S.L. BI - BIELLA</b>
PROT. ARRIVO N. <b>36744</b>
<b>- 9 DIC. 2010</b>
Ors
L'addetto Uff. Prot.

PROTOCOLLO INTERNO  
S.C. APPROVVIGIONAMENTO BENI

N° **583 - 10-12-2010**

Spettabile

**ASL BIELLA**

via Marconi, n. 23  
13900 - Biella


Alla personale attenzione del  
Responsabile del Procedimento.

**dott.ssa MARIA RAITERI**

A mezzo raccomandata con  
ricevuta di ritorno

anticipata via fax ai nn.  
015.3503545  
015.3503516

Torino, 7 dicembre 2010

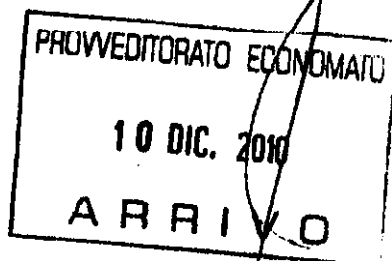

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area Coordinamento sovrazonale "NO" (AA.SS.LL BI, VC e NO, A.S.O. Maggiore della Carità di Novara); *"Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale"* ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184/2006. Diffida.

La società **MEDI FM SERVICE SRL**, con sede in Novara, via Giacomo Battistini n. 15, codice fiscale e partita IVA 01502740036, n. Rea NO-178063 ("Medi FM"), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. Filippo Cestagalli, espone quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 4 marzo 2010, l'Asl Biella (l'"Amministrazione") ha indetto procedura aperta per l'affidamento della fornitura di noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area Coordinamento sovrazonale "NO" (AA.SS.LL BI, VC e NO, A.S.O. Maggiore della Carità di Novara) per 36 mesi, più eventuale facoltà di rinnovo per




80

9-12-10 8:14/ASL BI PR



- ulteriori 24 mesi, per un valore stimato complessivo, IVA esclusa, di € 5.155.000 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'appalto comprende in particolare due distinti lotti, oggetto di aggiudicazione disgiunta: il Lotto n. 1 ha ad oggetto la fornitura di *"materassi a pressione alternata e/o bassa pressione d'appoggio"* per un importo stimato, IVA esclusa, di € 3.537.000; il Lotto n. 2 riguarda la fornitura di *"materassi a cessione d'urto (gestione microclima e macerazione)"* per un valore stimato, IVA esclusa, di € 1.618.000;
  - con specifico riferimento al *«Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o bassa pressione di appoggio – Sottolotto B»*, quanto alle *«Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste»*, negli atti di gara l'Amministrazione specifica che il prodotto offerto dovrà essere *«dotato di sensori interni per la rivelazione della pressione nella regione lombo-sacrale. Tale sensore deve permettere un adattamento continuo in funzione del peso e del posizionamento del paziente per mantenere basse pressioni di appoggio anche con paziente in posizione seduta»* (Allegato I; punto A-14, sotto lotto b);
  - entro la data del 14 aprile 2010, ore 10.00, prevista dal Bando di gara come termine ultimo per il ricevimento delle offerte, sono pervenute all'Amministrazione le seguenti tre offerte: i) Medi FM Service; ii) KCI Medical Srl e iii) Hill Rom Spa;
  - nel corso della seduta pubblica del 30 aprile 2010, la dott.ssa Leila Rossi in sostituzione della dott.ssa Maria Raiteri, Responsabile del Procedimento, ha proceduto: i) alla presa d'atto dell'avvenuto ricevimento dei plichi contenenti le offerte entro il termine del 16 aprile 2010, ore 16.00, indicato dal Bando di gara; ii) all'apertura dei precitati plichi ed alla verifica della loro regolarità formale; iii) all'apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa ed alla verifica della regolarità formale della stessa; iv) all'apertura dei plichi contenenti la Documentazione Tecnica ed alla verifica della documentazione ivi contenuta *«sulla base dell'elenco richiesto alla lettera B "Busta n. 2 – Documentazione tecnica"»* del Disciplinare di gara; v) alle operazioni di sorteggio per le verifiche di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, estraendo a sorte KCI Medical Srl;
  - nella medesima riunione, all'esito delle predette verifiche, l'Amministrazione nella persona della dott.ssa Leila Rossi ha dichiarato ammesse le offerte presentate da KCI Medical Srl e Hill Rom Spa per entrambi i lotti e l'offerta Medi FM per il Lotto n. 1 ed ammessa con riserva l'offerta Medi FM per il Lotto 2;
  - con lettera prot. 29634 del 21 settembre 2010, a firma del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria Raiteri, l'Amministrazione ha

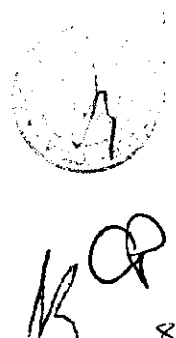

Handwritten signature and initials, possibly 'KCI' or 'Hill Rom', with the number '81' written below.

comunicato a Medi FM che, a seguito dello scioglimento della riserva del 30 aprile 2010, era stata ammessa alla gara anche per il Lotto n. 2, «ritenendo l'avvalimento presentato legittimo sulla base della documentazione agli atti»;

- la Commissione Giudicatrice ha dunque dato avvio alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate;
- in particolare, in base alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice ha proceduto, a quanto consta, non avendo ancora potuto acquisire i verbali delle relative riunioni, alla valutazione delle «*Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste*» a pena di esclusione» ed alle «*Caratteristiche e prestazioni tecnico/qualitative oggetto di valutazione*» (Disciplinare di gara, pag. 8);
- all'esito delle valutazioni di cui precedente punto ed in specie all'esito delle valutazioni attinenti alle «*Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste*» a pena di esclusione», la Commissione Giudicatrice, in ossequio alle previsioni del Disciplinare di gara, con lettera prot. 29737 del 1° ottobre 2010, ha richiesto a Medi FM di fornire entro i tre giorni successivi (e dunque entro il successivo 4 ottobre) precisazioni in ordine «alla caratteristica A-4 prevista nella sezione «*Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste*» dell'Allegato 1) Sotto lotto A: «Disponibilità gamma di materassi compatibili con letti di larghezza da 80 a 90 cm. e lunghezza da 190 a 200 cm in condizioni di gonfiaggio standard»»;
- nella predetta comunicazione, entro il medesimo termine, l'Amministrazione, al dichiarato fine di «poter consentire un esame approfondito del contenuto delle schede tecniche (Allegati 1 e 2)» ha richiesto altresì a Medi FM, così come – si ritiene – agli altri concorrenti ammessi alla gara, di «fornire, per ogni caratteristica «essenziale» (punti A-XX) e soggetta a «valutazione» (punti B-XX), i riferimenti (n°/nome documento, n° pagina, n° paragrafo, n° capitolo, etc.) dei documenti presentati atti ad individuare in modo più puntuale possibile le caratteristiche e le prestazioni proposte in gara»;
- con comunicazione in data 4 ottobre 2010, Medi FM ha provveduto ad ottemperare alle richieste avanzate dall'Amministrazione ed in particolare a precisare con riguardo alle «*Caratteristiche e prestazioni essenziali*» di cui al punto A-4 sotto lotto A dell'Allegato 1 che le relative indicazioni erano contenute nella «*dichiarazione del Produttore allegata*» alla stessa e con riguardo alle «*Caratteristiche e prestazioni essenziali*» di cui al punto A14 del medesimo Allegato 1 che le relative indicazioni erano contenute nel «*Depliant AIR EXPRESS* – pag. 2, paragr. 1, punti 1,2 – pag. 3, paragr. 2, punto 6 – pag. 5, paragr. 1, punti 1,2»;

82

- nel depliant citato prodotto da Medi FM unitamente all'offerta tecnica si legge infatti con espreso riguardo alla caratteristica di cui al punto A-14 sotto lotto b dell'Allegato 1: «Sensore di superficie a gestione pneumatica. Questo dispositivo garantisce l'adeguamento automatico delle pressioni di appoggio su tutta la superficie di supporto al paziente in funzione delle dimensioni, della sua morfologia specifica, della posizione assunta e delle prominenze ossee. Il sensore a gestione pneumatica esercita un controllo pressorio continuo, calibrando costantemente la superficie in relazione ad eventuali nuove condizioni determinate da una diversa concentrazione delle pressioni e dei carichi. Caratteristica peculiare del sensore è la capacità di lavorare ad infiniti livelli di autoregolazione, senza essere vincolato ad alcuna modularità derivante da livelli prestabiliti»;
- in data 4 novembre 2011 la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad effettuare la sessione di prova visione dei sistemi offerti da Medi FM presso l'Ospedale di Biella;
- con comunicazione prot. 36305 del 3 dicembre 2010, a firma della sig.ra Elena Maestrelli (la "Comunicazione"), la Commissione Giudicatrice – «ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera b)» del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – ha comunicato a Medi FM che «con verbale del 30.11.2010 la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la non idoneità del prodotto offerto [...] relativamente al Lotto 1 sotto lotto B (mod. AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) rispetto alle caratteristiche essenziali richieste a pena di esclusione»;
- in particolare, nella precitata comunicazione la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la non idoneità del prodotto offerto da Medi FM relativamente al Lotto 1 sotto lotto B in base alla seguente motivazione: «... il modello presentato dalla ditta MEDI FM (AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso. Tale caratteristica non risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara, ed in particolare dalla caratteristica espressa al punto A-14 (lotto di sensori interni per la rivelazione della pressione nella regione lombo-sacrale) che richiede la possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale)»



Handwritten signature and initials, including a large 'R' and the number '83'.

\* \* \*

La Comunicazione è illegittima in quanto viziata sotto innumerevoli profili, che è intenzione di Medi FM rilevare avanti alla competente Autorità Giurisdizionale nel caso in cui, alla luce delle ragioni che verranno qui di seguito sinteticamente proposte, l'Amministrazione non decida di intervenire direttamente con il mezzo dell'annullamento d'ufficio in via di autotutela.

\* \* \*

**1. SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI VIZI DI ILLEGITTIMITÀ E DEI MOTIVI DI RICORSO AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL D. LGS. 163/2006.**

**1.1 ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA VALUTAZIONE OPERATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.**

Erra la Commissione Giudicatrice quando afferma che il prodotto offerto da Medi FM non presenterebbe le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste ai sensi dell'Allegato 1, punto A 14.

Come già specificato da Medi FM nella nota 4 ottobre 2010, già a vostre mani, il sistema AIR EXPRESS (GAYMAR) offerto da Medi FM con riferimento al Lotto 1, sotto lotto B, è dotato di un sensore pneumatico con controllo continuo delle pressioni in grado di calibrare costantemente le pressioni stesse in relazione ad eventuali nuove condizioni (variazioni di postura) determinate da una diversa concentrazione delle pressioni.

Tale sensore "lavora", dunque, ad infiniti livelli di autoregolazione e non è vincolato da livelli prestabiliti in base al peso o all'altezza del paziente.

Il prodotto offerto da Medi FM è, pertanto, certamente in possesso delle caratteristiche e prestazioni essenziali richieste dall'Allegato 1 e in particolare è certamente «dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale»; segnatamente, il sensore interno al prodotto Medi FM è idoneo a «permettere un adattamento continuo in funzione del peso e del posizionamento del paziente per mantenere basse pressioni di appoggio anche con paziente in posizione seduta».

Dunque, è del tutto erronea l'affermazione della Commissione Giudicatrice secondo cui «il cambio di postura mantiene infatti la pressione media ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale»; infatti, la funzione di tale sensore è proprio quella di diminuire la pressione a livello lombo-sacrale nel caso in cui il paziente si trovi in posizione semiseduta e riequilibrarla su tutta la superficie delle celle in modo da mantenere

livelli di pressione e di contatto sempre al di sotto dei 32 mm Hg, in ogni punto, per almeno il 70% dell'intero ciclo di lavoro (cfr. nostra dichiarazione allegata agli atti di gara).

Dunque, è certamente erronca l'interpretazione fornita dalla Commissione Giudicatrice relativamente alle specifiche tecniche fornite dal nostro incaricato intervenuto alla prova-visione; non è affatto vero che il nostro incaricato abbia mai dichiarato che *«il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso»*.

Del resto, che il possesso, da parte del prodotto Medi FM, delle caratteristiche di cui all'Allegato 1 sia pacifico risulta ampiamente e chiaramente anche dalla documentazione tecnica offerta in gara da Medi FM stessa ed erroneamente ignorata – o, quantomeno, male interpretata – dalla Commissione Giudicatrice.

#### 1.2. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO.

La valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice è illegittima anche perché viziosa da eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà e dello sviamento.

Con la nota del 1° ottobre 2010, la Commissione Giudicatrice ha richiesto a Medi FM chiarimenti in merito alla documentazione presentata, nulla, però, rilevando con specifico riferimento alla caratteristica di cui al punto A 14 dell'Allegato 1 nonostante, già in allora, la Commissione Giudicatrice stessa fosse già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi idonei a consentirle, se del caso, di formulare specifiche richieste di chiarimento in merito alle caratteristiche di cui al punto A 14 dell'Allegato 1.

Ciò significa che la Commissione Giudicatrice aveva evidentemente già espresso, alla data del 1° ottobre 2010, un esplicito giudizio di idoneità del prodotto con riferimento, in particolare, alla caratteristica di cui al punto A 14 dell'Allegato 1, non avendo, sul punto, avvertito l'esigenza di alcun approfondimento.

Da qui la manifesta contraddittorietà della condotta della Commissione Giudicatrice.

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto ai punti 1.1. e 1.2., Medi Fm insta affinché l'Amministrazione annulli d'ufficio in via di autotutela il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice nella Comunicazione, assumendo ogni conseguente provvedimento anche inerente alla definitiva ammissione di Medi FM a concorrere per l'aggiudicazione del Lotto 1.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

85

### 1.3. RISERVA.

Medi Fm formula ogni più ampia riserva di formulare, in caso di ricorso avanti all'Autorità Giudiziaria, altre e diverse censure in merito alla procedura, nonché, se necessario ed anche alla luce della documentazione della quale si richiede l'accesso, di modificare i motivi di censura qui proposti.

### 2. DIFFIDA.

Alla luce delle considerazioni svolte e data l'evidente illegittimità dell'operato della Commissione Giudicatrice, si invita e diffida l'Amministrazione a non porre in essere alcun ulteriore atto della procedura fino a che l'Amministrazione stessa non avrà comunicato le proprie determinazioni in ordine ai motivi qui indicati.

Un eventuale comportamento contrario da parte dell'Amministrazione, oltre a presentarsi contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità costituzionalmente sanciti, sarebbe contrario al principio generale di buona fede al quale deve necessariamente ispirarsi l'operato della pubblica amministrazione ed in ogni caso valutabile ai fini della decisione sulle spese del giudizio che Medi Fm eventualmente instaurerà, nonché ai sensi dell'articolo 1227 c.c.

### 3. ISTANZA DI ACCESSO.

Al fine di tutelare e difendere i propri interessi giuridici, Medi FM richiede di esercitare il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 184/2006, prendendo visione ed estraendo copia:

- di tutti i verbali delle riunioni svoltesi sia in seduta privata sia in seduta pubblica, ivi compresi quelli relativi alle sedute del 30 aprile 2010, del 12 maggio 2010 e del 30 novembre 2010;
- delle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti e, comunque, di tutta la documentazione presentata da tali società nell'ambito della procedura, ivi compresa quella attestante il possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione;
- della determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice.
- e, comunque, tutti gli atti ed i documenti in qualunque modo inerenti alla procedura di gara in menzione.

Si ricorda che, a norma dell'art. 79, 5 quater del D. Lgs. 163/2006, «l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia».

Dunque, l'accesso dovrà essere in ogni caso consentito entro il 13 dicembre 2010; vi informiamo, sin da ora che – salvo vostra diversa indicazione in merito ad altri giorni di disponibilità antecedenti a quello da noi indicato – ci recheremo presso la vostra sede nella giornata del 13 dicembre 2010 stesso per prendere visione ed estrarre copia dei documenti della procedura.

\* \* \*

Si richiede di inviare ogni comunicazione in qualunque modo inerente al presente procedimento all'attenzione degli avvocati ALESSANDRA CARDELLA e FILIPPO TRAVIGLIA, eleggendo, a tal fine, domicilio presso lo STUDIO LEGALE MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI, via Ettore De Sonnaz, n. 14, 10121, Torino (tel 011/2170911, fax 011/2170900, e-mail: [alessandra.cardella@madlex.it](mailto:alessandra.cardella@madlex.it); [filippo.traviglia@madlex.it](mailto:filippo.traviglia@madlex.it)).

Medi FM Service Srl



**A.S.L. BI**Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-350345  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**S.O.C. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI**Direttore: Dott.ssa Maria Raiteri  
Ospedale degli Infermi  
Via Caraccio, 5/a - 13900 Biella  
Tel. 015-3503693-449  
elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI  
SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. dell'AREA DI  
COORDINAMENTO SOVRAZIONALE "NO" per la durata di 36 mesi.**

**VERBALE N° 2***Commissione giudicatrice nominata con Delibera 52 del 04.02.2011*

In data 21 marzo 2011 alle ore 9,30 presso i locali della S.O.S. Direzione delle Professioni Sanitarie del Presidio Ospedaliero di Via Caraccio, 5 ha inizio la seconda seduta della Commissione giudicatrice competente a valutare la qualità delle offerte delle ditte partecipanti alla Procedura Aperta in oggetto.

La Commissione giudicatrice, individuata con deliberazione del Commissario n° 52 del 04.02.2011, risulta così composta:

- Dott.ssa Maria Raiteri- Responsabile della S.O.C. Approvvigionamento di Beni - Presidente
- Sig. Massimo Poletti - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Veronica Sclanguetta - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Anna Riso - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Sig.ra Roberta Pesca - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Componente;
- Rag. Elena Maestrelli - Collaboratore Amministrativo della S.O.C. Approvvigionamento di Beni: Segretaria verbalizzante.

La Commissione, presente al completo, prende atto che nella precedente seduta del 07/03/2011, dopo attento esame degli atti, ha:

- approvato tutti gli adempimenti istruttori affidati alla sottocommissione della Commissione Giudicatrice nominata con Delibera del Direttore Generale n° 461 del 14.07.2010, compresa la prova visione;
- proceduto ad una rivalutazione autonoma delle offerte tecniche presentate da tutte le ditte partecipanti ed in particolare riesaminato la posizione della ditta MEDI FM alla luce delle osservazioni da questa mosse con nota del 07.12.2010;
- assegnato i giudizi secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara";
- ritenuto non idoneo il presidio mod. AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR, offerto per il lotto 1) sotto lotto B), dalla ditta MEDI FM.



www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura  
senza cuore

Servizio Sanitario Regionale del Piemonte

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'FR' and several other illegible signatures.





**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015 3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

In data odierna la Commissione Giudicatrice procede ad attribuire i punteggi relativi ai giudizi espressi nella seduta precedente, come stabilito dal Disciplinare di gara al paragrafo "Modalità di espletamento della gara, che di seguito si dettagliano.

**Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio-**

Poiché il Disciplinare di gara prevede che il Lotto 1) venga aggiudicato in presenza di offerta congiunta per entrambi i sottolotti A e B, avendo la ditta MEDI FM ottenuto un giudizio di non idoneità sul sottolotto B relativamente al presidio AIR EXPRESS, la Commissione Giudicatrice all'unanimità esclude la ditta MEDI FM dall'intero Lotto 1.

Relativamente alle ditte HILL ROM e KCI la Commissione Giudicatrice procede ad attribuire i seguenti punteggi.

**Sottolotto A**

		Punti 25	HILL ROM (Primo)	KCI (Air WorkSure)
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	13	13	10,4
B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	7	7	7
B-3	Portata terapeutica	3	2,4	2,4
B-4	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	2	2	2
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>24,4</b>	<b>21,8</b>

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/units



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and stamps]*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

**SEDE LEGALE**

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel 015.35031 Fax 015.3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**Sottolotto B**

		Punti 25	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)
B-1	Pressione di contatto, su ogni punto del corpo, per percentuale nel tempo in cui viene mantenuta e altezza della parte dinamica.	13	13	10,4
B-2	Servizio sia ospedaliero che territoriale	7	7	7
B-3	Portata terapeutica	3	2,4	3
B-4	A. Alfami B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	2	2	2
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>24,4</b>	<b>22,4</b>

**TOTALE LOTTO 1**

	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)
SOTTO LOTTO A	24,4	21,8
SOTTO LOTTO B	24,4	22,4
<b>TOTALE LOTTO 1</b>	<b>48,8</b>	<b>44,2</b>

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura  
senza cuore**

Assessorato Sanitario Regionale del Piemonte

*[Handwritten signatures and initials]*  
Dec 90



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

**Lotto 2: Materassi a Cessione d'aria (gestione microclima e macerazione)**

		Punti 50	HILL ROM (Cline Active + MCM)	KCI (THERAKAIR VISION)	MEDI FM SERVICE (Air Express)
B-1 e B-2	Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie e Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti	14 + 12	13	26	13
B-3	Servizio sia ospedaliero che territoriale	11	11	11	5,5
B-4	Altezza parte dinamica/parte statica	8	4	8	4
B-5	A. Allarmi B. Gamma di materassi C. Sistemi di aggancio al letto	5	5	5	5
	<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>50</b>	<b>27,5</b>

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla normalizzazione dei punteggi:

**Lotto 1**

	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)
<b>TOTALE LOTTO 1</b>	<b>48,8</b>	<b>44,2</b>
<b>PUNTEGGIO NORMALIZZATO</b>	<b>50</b>	<b>45,286</b>

**Lotto 2**

Per il Lotto 2 avendo la ditta KCI ottenuto 50 punti su 50 non è necessario procedere a tale operazione in quanto i punteggi sono già normalizzati a 50.

	HILL ROM (Cline Active)	KCI (Proficare)	MEDI FM SERVICE (Air Express)
<b>PUNTEGGIO NORMALIZZATO</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>27,5</b>

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/ranife



**Non c'è cura  
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

La Commissione da atto che la seduta è stata sospesa per la pausa del pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00.

La seduta si chiude alle ore 15,15

Viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto

Dott.ssa Maria Raiteri ..... *M. Raiteri* .....

Sig. Massimo Poletti ..... *M. Poletti* .....

Sig.ra Veronica Scianguetta ..... *V. Scianguetta* .....

Sig.ra Roberta Pesce ..... *R. Pesce* .....

Sig.ra Anna Riso ..... *A. Riso* .....

Rag. Elena Maestrelli segretaria verbalizzante ..... *E. Maestrelli* .....

\*\*\*\*\*



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura  
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**IL DIRETTORE**  
**SOC. FORNITURE E LOGISTICA**  
**(Dott. Federico BONISOLI)**

